

 DAC-SpectroMed s.r.l. МД-2012, Молдова, г. Кишинев, ул. Армянская, 47, кв. 64 Тел.: +37322/574900, 574922/23; факс: +37322/574920 Email: office@dacspectromed.com www.dacspectromed.com	Anti-HCV-S-Cart-DAC Код 4182AHCV1 1 тест	РТ MD 11-15796482-005:2006 Только для диагностики « <i>in vitro</i> » Хранить при 18-30°C
Тест-картридж для определения антител к вирусу гепатита С в сыворотке и плазме		

ВВЕДЕНИЕ

Anti-HCV-S-Cart-DAC является экспресс тестом прямого связывания для визуального определения антител к вирусу гепатита С (anti-HCV) в сыворотке при диагностике гепатита С.

Одноэтапный тест основан на принципе иммунологического анализа сэндвичевого типа с двойным антигеном белка для определения антител к вирусу гепатита С в сыворотке. Для специфического выявления антител к вирусу гепатита С используются очищенные рекомбинантные антигены белка.

Чувствительность теста – 2 ng/ml

Данный одноэтапный тест занимает по времени около 10-20 минут.

Результаты тестачитываются визуально без помощи прибора.

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Индивидуально упакованный тест-картридж с влагопоглотителем и пластиковой пипеткой.
- Инструкция

СБОР ПРОБ


Для получения сыворотки следует собрать кровь в контейнер без антикоагулянта. Оставьте кровь сворачиваться и отделите сыворотку из сгустка. Сыворотку используйте для тестирования.

Если тестирование пробы не может быть произведено в тот же день, храните пробу в холодильнике или морозильнике. Перед тестированием доведите пробы до комнатной температуры.

Повторное замораживание проб не допустимо.


ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

- Перед началом тестирования откройте упаковку, надорвав по отметке. Извлеките тест из упаковки и установите на ровную чистую поверхность.
- Наберите 0,20 мл (около 4 капель) образца в пипетку, и добавьте их в лунку для образца на картридже.
- Инкубируйте 10-20 минут и считайте результат. Не считывайте результат спустя 30 минут.

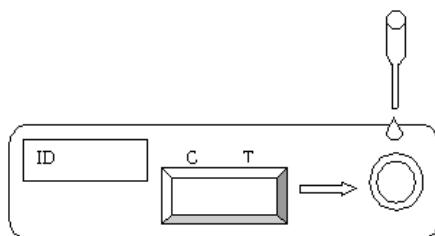

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

- **Negative (отрицательный):** появляется только одна цветная линия на контрольном участке. На тестовом участке видимая линия не появляется.
- **Positive (положительный):** в дополнение к контрольной линии розового цвета на тестовом участке также появляется четкая линия розового цвета.
- **Invalid (недействительный):** полное отсутствие окрашивания на обоих участках является индикатором ошибки в процедуре и/или порчи реагента.

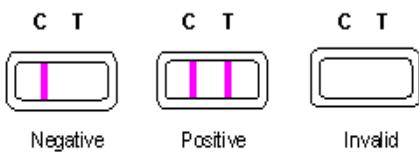

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Тест-набор можно хранить при комнатной температуре (18-30°C) в запечатанной упаковке до истечения срока годности. Тест-набор следует беречь от прямых солнечных лучей, влажности и тепла.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Только для диагностики *in vitro*.
- Не использовать тест-набор после истечения срока годности.
- Тест-устройство не следует использовать повторно.