

НАБІР РЕАГЕНТІВ

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАНЕЛІ АНЕМІЇ VAST:

ФОЛАТУ І ВІТАМІНУ В12

МЕТОДОМ ІФА

Folate, Vitamin B12 (Anemia Panel VAST) Test System

Кат. №: 7825-300A

Дата випуску інструкції: 16-07-2019

Версія: 3



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу і перекладу інструкції повинні збігатися.

1.0 ВСТУП

Призначення: Кількісне визначення концентрації Вітаміну В12 та Фолату в сироватці і плазмі людини за допомогою ІФА, Колориметричний.

2.0 ПОЯСНЕННЯ ТЕСТУ

Фолат відіграє важливу роль у розвитку мозку і тому життєво важливий під час росту. Найбільш поширеними дефектами, що виникають унаслідок дефіциту фолатів, є дефекти нервової трубки. З тим, що фолат займає важливе місце у синтезі нуклеїнових кислот, було визнано, що додавання фолатів корисно під час вагітності та інших випадків швидкого росту тканин. Фолат також відіграє вирішальну роль у підтримці належного балансу гомоцистеїну, що є фактором, який сприяє виникненню оклюзійних судинних захворювань та інсульту. Особи зі склонністю до хвороб серця та деяких форм раку можуть також використовувати добавки.^{1,2,3}

Основними джерелами фолієвої кислоти є зелені листові овочі, бобові, боби та збагачені крупи. Продукти, збагачені фолієвою кислотою, фактично збагачені фолієвою кислотою через більшу біодоступність для всмоктування організмом. В обігу фолат присутній у кількох різних формах, деякі з яких стабільніші за інших. Фолієва кислота та N-methyltetrahydrofolate є двома загальноприйнятими формами, остання є більш стійкою і виявляється у більш високих концентраціях у сироватці. Через стабільність молекули methyltetrahydrofolate дуже часто застосовується як форма, на яку орієнтується під час аналізів.^{3,4}

Фолатні зв'язуючі білки відповідають за метаболізм фолатів. У кровообігу існують два типи: один тип приймає участь у зв'язування з поверхнею клітин, а інша розчинна форма існує в кровообігу. Ці білки, що зв'язують фолат, також мають здатність зв'язувати декілька різних похідних фолату, включаючи фолієву кислоту та N-methyltetrahydrofolate. Взаємодія фолієвої кислоти з білками, що зв'язують фолат, є сильнішою, ніж methyltetrahydrofolate. Поточні аналізи на ринку вимагають етапу екстракції для вивільнення похідних фолату з білка, зв'язуючого фолат.^{4,5}

Вітамін В12 - це один з дев'яти водорозчинних вітамінів, важливих для функціонування здорового організму.

Найважливіші ролі вітаміну В12 в організмі людини - це формування еритроцитів та утворення мієлінової оболонки навколо нервів. Оскільки ефекти спостерігаються в системах організму з великим діапазоном функцій, симптоми дефіциту вітаміну В12 іноді можуть бути дуже неоднозначними. Дефіцит також може тривати від місяців до років, щоб проявитися, залежно від причини та ступеню тяжкості.^{6,7,8}


Дві з найпоширеніших причин дефіциту вітаміну В12 - дієта та вік. Оскільки основним джерелом вітаміну В12 є тварини, вегани, які не ефективно доповнюють свою дієту, піддаються ризику. Люди похилого віку також піддаються підвищенню ризику через їх дієту, а також менш ефективне функціонування їх травної системи.^{6,8,9}

Два дуже корисних тести для розмежування дефіциту вітаміну В12 та дефіциту фолієвої кислоти: метилмалоніл CoA (MMA) та гомоцистеїн (hcy). Обидва дефіцити представлені подібними симптомами; однак, хоча обидва з них показують підвищений рівень гомоцистеїну, лише дефіцит вітаміну В12 викликає збільшення метилмалонілу CoA. Вважається, що підвищення рівня метилмалонілу CoA та гомоцистеїну є основною причиною будь-яких симптомів, що супроводжують дефіцит вітаміну В12. Високий рівень цих двох аналітів у крові породжує підвищений окислювальний стрес клітин, що викликає підвищений апоптоз. У свою чергу, судинне захворювання призводить до атеросклерозу, ішемічної хвороби серця та/або нейродегенерації (наприклад, хвороби Паркінсона).^{6,10,11}

3.0 ПРИНЦІП МЕТОДУ

Фолат - Аналіз конкурентного зв'язування білків (ТИП 8):

Необхідні реагенти для конкурентного зв'язування включають білок специфічного зв'язування, кон'югат фермент-антіген та нативний антіген. При змішуванні кон'югату фермент-антіген, біотинильованого зв'язуючого білка і сироватки, що містить нативний антігеном і кон'югатом фермент-антіген за обмежену кількість сайтів зв'язування. Взаємодія описується наступним рівнянням:



BP_{Bln} = Біотинильований зв'язуючий білок (постійна величина)

Ag = Нативний антіген (змінна величина)

EnzAg = Кон'югат фермент-антіген (постійна величина)

BP_{Bln} = Комплекс антиген-зв'язуючий білок

$\text{EnzAgBP}_{\text{Bln}}$ = Комплекс фермент-антіген-зв'язуючий білок

k_a = Постійна швидкості асоціації

k_{-a} = Постійна швидкості дисоціації

$K = k_a/k_{-a}$ = Константа рівноваги

Відбувається одночасна взаємодія між біотином, прикріпленим до зв'язуючого білка, та стрептавідином, іммобілізованим на поверхні мікролунки. Це впливає на поділ пов'язаної фракції ферменту зв'язуючого білка після декантації або аспірації.

$\text{AgAb}_{\text{Bln}} + \text{EnzAgBP}_{\text{Bln}} + \text{Streptavidin}_{\text{CW}} \Rightarrow \text{іммобілізований комплекс}$


$\text{Streptavidin}_{\text{CW}}$ = Стрептавідин, іммобілізований на поверхні лунки

Іммобілізований комплекс = сандвіч-комплекс, пов'язаний з твердою поверхнею

Активність ферменту в фракції зв'язування білка обернено пропорційна концентрації нативного антігену. Використовуючи декілька різних референтних сироваток з відомою концентрацією антігену, будеться крива, з якої концентрація антігенів у невідомих зразках може бути встановлена.

Вітамін В12 - Конкурентний імуноаналіз з затримкою (ТИП 9):

Реагенти, що вимагаються для твердофазного імуноферментного аналізу, включають антитіла, кон'югат ферменту з антігеном і нативний антіген. При змішуванні біотинильованих антитіл з антігеном, що містить сироватку, відбувається реакція між антігеном і антитілом. Взаємодія ілюструється наступним рівнянням:




Ab_{Bln} = біотинильовані антитіла

Ag = антіген (змінна кількість)

AgAb_{Bln} = комплекс антиген-антитіло

Після короткої інкубації додається ферментний кон'югат (це відкладене на пізніше додавання дозволяє підвищити чутливість для зразків з низькою концентрацією). Після додавання ферментного кон'югату відбувається конкурентня між ферментним аналогом і антігеном в зразку за обмежену кількість зв'язуючих сайтів (не використаних в першій інкубації).



EnzAg = кон'югат фермент-антіген (постійна величина)

$\text{EnzAgAb}_{\text{Bln}}$ = комплекс кон'югат – антитіло

rAb_{Bln} = біотинильоване антитіло, яке не прореагувало під час першої інкубації

k_a = константа швидкості асоціації

k_{-a} = константа швидкості дисоціації

$K = k_a/k_{-a}$ = константа рівноваги

Відбувається реакція між біотином, пов'язаним з антитілами, і Стрептавідином, іммобілізованим в лунках мікропланшетів. Це дозволяє відокремити фракцію, пов'язану з антитілами, при декантуванні або аспірації.

$\text{AgAb}_{\text{Bln}} + \text{EnzAgAb}_{\text{Bln}} + \text{Streptavidin}_{\text{CW}} \Rightarrow \text{іммобілізований комплекс}$

Стрептавідин = стрептавідин, іммобілізований в лунках

Іммобілізований комплекс = «сендвіч» комплекс, пов'язаний з твердою фазою (поверхнею лунок)

Активність ферменту у фракції пов'язаних антитіл обернено пропорційна концентрації нативного антигена. При використанні декількох стандартів з відомим значенням концентрації антигена будесяться калібрувальна крива, по якій обчислюється концентрація в зразках.

4.0 РЕАГЕНТИ

Матеріали, що постачаються, для 96 лунок:

A. Комбіновані Калібратори Фолат/Вітамін B12 - 1 мл (ml)/флакон

6 флаконів референсної сироватки з концентраціями, зазначеними нижче. Містить консерванти.

Калібратори на основі людської сироватки були відкалібровані при використанні референсних препаратів, зазначених в таблиці.

Аналіт	Фолат (нг/мл (ng/ml))	Вітамін B12 (пг/мл (pg/ml))
A	0.0	0
B	1.0	125
C	2.5	250
D	5.0	500
E	10.0	1000
F	25.0	2500

B. Ферментний реагент Фолату - 7.0 мл (ml)/флакон

Один (1) флакон, що містить кон'югат Фолат (аналог)-пероксидаза хрону (HRP) в білковій стабілізуючій матриці з барвником. Зберігати при температурі 2-8 °C (°C).

C. Біотиновий реагент Фолату - 7.0 мл (ml)/флакон

Один (1) флакон, що містить кон'югат біотинильований очищений фолат-зв'язуючий білок в буфері, барвник і консервант. Зберігати при 2-8 °C (°C).

D. Ферментний реагент Вітаміну B12 - 7.0 мл (ml)/флакон

Один флакон, що містить Вітамін B12 (аналог) з пероксидазою хрону (HRP) в білковому стабілізуючому розчині. Зберігати при 2-8 °C (°C).

E. Біотинильований Вітамін B12 - 7.0 мл (ml)/флакон

Один флакон, що містить біотинильовані антитіла до Вітаміну B-12, очищені кон'юговані кролячі IgG в буфері, барвник, консервант. Зберігати при 2-8 °C (°C).

F. Концентрат буфера для промивок - 20.0 мл (ml)/флакон

Один флакон, що містить ПАР в фосфатному сольовому буфері. Містить консервант. Зберігати при 2-8 °C (°C) до 60 днів.

G. Планшет, покритий Стрептавідином - 96 лунок

Один 96-лунковий мікропланшет, покритий стрептавідином і запакований в алюмінієву фольгу з осушувачем. Зберігати при 2-8 °C (°C).

H. Реагент субстрату - 12 мл (ml)/флакон

Один флакон, що містить ТМБ і перекис водню в буфері. Зберігати при 2-8 °C (°C).

I. Стоп-розчин - 8.0 мл (ml)/флакон

Один флакон, що містить сильну кислоту (0.5M (M) H₂SO₄). Зберігати при 2-8 °C (°C).

J. Вивільнюючий агент - 14.0 мл (ml)/флакон

Один флакон, що містить сильну основу (гідроксид натрію) і ціанід калію. Зберігати при 2-8 °C (°C).

K. Стабілізуючий агент - 0.7 мл (ml)/флакон

Один флакон, що містить розчин ТСЕР. Зберігати при 2-8 °C (°C).

L. Нейтралізуючий буфер - 7.0 мл (ml)/флакон

Один флакон, що містить буфер з барвником, що знижує pH екстракції зразка. Зберігати при 2-8 °C (°C).

M. Інструкція до набору.

Заваження 1: Не використовуйте реагенти з вичерпанім терміном придатності.

Заваження 2: Уникайте тривалого впливу тепла і світла. Відкриті реагенти стабільні 60 днів при зберіганні від 2 до 8 °C (°C). Стабільність набору і компонентів позначені на етикетці.

Заваження 3: Перераховані реагенти для одного 96-лункового мікропланшета.

4.1 Необхідні, але не надані з набором матеріали

1. Мікродозатори на 50 і 100 мкл (μl) з точністю не більше 1.5%
2. Диспенсери на 100 і 350 мкл (μl) з точністю не більше 1.5%
3. Диспенсери змінного об'єму (200-1000 мкл (μl)) для кон'югату
4. Скляні тестові пробірки для калібраторів, контролів і зразків
5. Мікропланшетний вишор або пляшка під тиском
6. Мікропланшетний рідер з фільтрами 450 нм (nm) і 620 нм (nm)
7. Фільтрувальний папір для висушування лунок
8. Поліетиленова плівка або кришка для інкубації мікропланшетів

9. Вакуумний аспіратор (опційно) для промивання
10. Таймер

5.0 ЗАУВАЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

*Набір призначений тільки для діагностики in vitro
Не для внутрішнього або зовнішнього використання
на людях або тваринах*

Використовується для виготовлення компонентів набору людська сироватка протестована методами, схваленими FDA, в яких отримані негативні результати на наявність антитіл до ВІЛ 1 та 2, ВГС і поверхневого антигена гепатиту В. Однак, оскільки не існує методів, що дають повну гарантію відсутності інфекційних агентів, з реагентами слід поводитися з обережністю, як з потенційно небезпечним біоматеріалом, що рекомендується для будь-яких зразків крові згідно правил кваліфікованої лабораторної практики. Рекомендації дівіться в національних посібниках з біобезпеки або, наприклад, в "Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories," 2nd Edition, 1988, HHS.

Безпечна утилізація компонентів набору повинна проходити відповідно до місцевих регулятивних і нормативних вимог.

6.0 ЗБІР І ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ

Зразками служать сироватка крові, плазма за типом. Дотримуватись звичайних запобіжних заходів при зборі зразків венепункцією. Для точного порівняння, щоб встановити нормальні значення, зразок сироватки повинен бути отриманий натхнене серце вранці. Кров слід збирати в пробірки з чорвоним верхом Redtop (з або без добавок гелю) або для плазми використовувати вакуумні трубки, що містять гепарин. Дайте крові згорнутися для зразків сироватки. Центрифугувати зразки, щоб відокремити сироватку або плазму від клітин.

У пацієнтів, які отримують терапію високими дозами біотину (тобто > 5 мг (mg)/добу), не слід брати зразок до принаймні 8 годин після останнього введення біотину, переважно протягом ночі, щоб забезпечити вибірку голодування.

Зразки можуть зберігатися при 2-8 °C (°C) до 5 днів. Якщо зразки не можуть бути проаналізовані протягом цього часу, то вони можуть зберігатися при температурі -20 °C (°C) протягом до 30 днів. Уникайте використання забруднених пристрій. Уникайте повторного заморожування і відтавання. При аналізі в дублікатах необхідно 100 мкл (μl) зразка для кожного маркера анемії.

7.0 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Кожна лабораторія повинна використовувати контролі в низькому, середньому та високому діапазоні значень для відстеження характеристик набору. Ці контролі повинні досліджуватися як невідомі зразки в кожній постановці аналізу. Повинні будуватися карти контролю якості для відстеження характеристик реагентів, що поставляються. Слід застосовувати прийнятні статистичні методи для встановлення відхилень. Значні відхилення від встановлених характеристик можуть свідчити про зміни в умовах експерименту або зниження якості реагентів набору. Для визначення причини змін повинні бути використані свіжі реагенти.

8.0 ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ

1. Буфер для промивок

Розбавте концентрат розчину для промивання до 1000 мл (ml) дистилльованою або деіонізованою водою. Зберігайте при кімнатній температурі (2-30 °C (°C)) до 60 днів.

2. ЕКСТРАКЦІЙНИЙ АГЕНТ

Додати аліквоту стабілізуючого агента для того, щоб підготувати 1/40 (стабілізуючий агент/вивільнюючий агент) розведеного розчину. Наприклад, щоб підготувати 4 мл (ml) (4000 мкл (μl)), додати 0.100 мл (ml) (100 мкл (μl)) стабілізуючого агента до 3.9 мл (ml) (3900 мкл (μl)) вивільнюючого агента.

3. ЕКСТРАКЦІЯ ЗРАЗКА (Див. примітку 3)

Підготувати достатню кількість пробірок для підготовки всіх зразків пацієнтів, контролів і калібраторів. Розлити 0.10 мл (ml) (100 мкл (μl)) всіх зразків в окремі пробірки. Піpetувати 0.050 мл (ml) (50 мкл (μl)) підготовленого екстракційного агента в кожну пробірку, струшуючи (див. примітку 3) після кожного додавання. Дозволити реакції протікати протягом 15 хвилин. Наприкінці 15 хвилин додати 0.050 мл (ml) (50 мкл (μl)) нейтралізуючого буфера, перемішати (див. примітку 3).

Для Фолату: Після додавання нейтралізуючого буфера і перемішування, завершити реакцію, і зачекати додатково 5 хвилин перед внесенням в лунки. Час очікування не потрібен для вітаміну B12.

Примітка 1: Не використовуйте робочий розчин субстрату, якщо він прибав бактерії.

Примітка 2: Не використовувати забруднені реагенти і реактиви з видимим ростом бактерій.

Примітка 3: Рекомендується використання мультисенсорного (3) вортекса.

Примітка 4: Надзвичайно важливим є точне дозування правильного об'єму з використанням каліброваною піпетки і внесення близько до нижньої частини скляних пробірок під кутом, торкаючись стінки пробірки.

Примітка 5: Зразки з високою концентрацією білка слід розбавити 1:1 фізіологічним розчином перед виконанням екстракції.

Примітка 6: Див. www.mono-bind.com/education-center щодо покрокового керівництва по екстракції зразка для Вітаміну B12 (&фолієвої кислоти).

9.0 ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ

Перед початком аналізу всі реагенти, стандарти і контролі повинні досягти кімнатної температури (20-27 °C (°C)).

Процедура тестування повинна виконуватися кваліфікованою людиною або навченим професіоналом

Для фолієвої кислоти:

- Підготуйте всі зразки відповідно до процедури «Екстракція зразка» в розділі «8.0 Підготовка реагентів»; важливо почекати 5 хвилин, перш ніж продовжити, щоб дозволити реакції нейтралізації йти до завершення (див. вище).
- Виберіть необхідну кількість лунок для зразків, стандартів і контролів для постановки в дублях. Поверніть невикористані смужки в алюмінієвий пакет і закройте його. Зберігайте при 2-8 °C (°C).
- Додайте піпеткою по 50 мкл (μl) відповідних екстрагованих калібратора Фолату, контролю або зразка у відповідні лунки.
- Додати 0.050 мл (ml) (50 мкл (μl)) ферментного реагенту Фолату в усі лунки.
- Струшуйте мікропланшет обережно протягом 20-30 секунд для перемішування.
- Додайте по 0.050 мл (ml) (50 мкл (μl)) Біотинового реагенту Вітаміну Фолату в кожну лунку.
- Добре перемішайте мікропланшет протягом 20-30 секунд.
- Накрійте мікропланшет і інкубуйте 45 хвилин при кімнатній температурі.
- Видаліть вміст лунок декантацією або аспірацією. Висушіть планшет на фільтрувальному папері, якщо використовувалася декантація.
- Додайте 350 мкл (μl) промивного буфера (див. розділ «Приготування реагентів») і видаліть його. Повторіть процедуру ще два рази (загальна кількість циклів промивки - 3). Для цієї процедури краще використовувати автоматичний або ручний вощер відповідно до інструкції виробника приладів. Якщо використовується пляшка під тиском, наповнити кожну лунку до верху (унікайте повітряних бульбашок). Видаліть розчин і повторіть 2 додаткових рази.
- Додайте по 100 мкл (μl) Робочого розчину субстрату в кожну лунку. Завжди додавайте реагенти в одній і тій же послідовності і з однаковою швидкістю, щоб уникнути відмінностей у часі реакції в різних лунках.

НЕ СТРУШУЙТЕ ПЛАНШЕТ ПІСЛЯ ДОДАВАННЯ СУБСТРАТУ

- Інкубуйте 20 хвилин при кімнатній температурі.
- Зупиніть розвиток забарвлення додаванням в кожну лунку 50 мкл (μl) стоп-розчину і перемішайте протягом 15-20 секунд. Завжди додавайте реагенти в одній і тій же послідовності і з однаковою швидкістю, щоб уникнути відмінностей у часі реакції в різних лунках.
- Виміряйте величини поглинання кожної лунки на довжині хвилі 450 нм (nm) (вимірювання проводити при референтній довжині хвилі 620-630 нм (nm)). Виміри повинні бути проведені протягом 30 хвилин після додавання стоп-розчину.

НЕ СТРУШУЙТЕ ПЛАНШЕТ ПІСЛЯ ДОДАВАННЯ СУБСТРАТУ

- Інкубуйте 20 хвилин при кімнатній температурі.

- Зупиніть розвиток забарвлення додаванням в кожну лунку 50 мкл (μl) стоп-розчину і перемішайте протягом 15-20 секунд. Завжди додавайте реагенти в одній і тій же послідовності і з однаковою швидкістю, щоб уникнути відмінностей у часі реакції в різних лунках.
- Виміряйте величини поглинання кожної лунки на довжині хвилі 450 нм (nm) (вимірювання проводити при референтній довжині хвилі 620-630 нм (nm)). Виміри повинні бути проведені протягом 30 хвилин після додавання стоп-розчину.

Примітка 1: Розвести зразки з концентраціями вище 25 нг/мл (ng/ml) 1:5 з Калібратором Фолату '0' нг/мл (ng/ml) і повторіти аналіз.

Примітка 2: Дуже важливо вносити всі реагенти в центр лунки. Завжди додавайте реагенти в тому ж порядку, щоб мінімізувати різницю часу реакції між лунками.

Для Вітаміну B12:

- Виберіть необхідну кількість лунок для зразків, стандартів і контролів для постановки в дублях. Поверніть невикористані смужки в алюмінієвий пакет і закройте його. Зберігайте при 2-8 °C (°C).
- Додайте піпеткою по 50 мкл (μl) відповідних екстрагованих калібратора Вітаміну B12, контролю або зразка у відповідні лунки.
- Додати 0.050 мл (ml) (50 мкл (μl)) Біотинового Реагенту Вітаміну B12 в усі лунки.

- Струшуйте мікропланшет обережно протягом 20-30 секунд для перемішування.
- Накрійте та інкубуйте 45 хвилин при кімнатній температурі.
- Додайте по 0.050 мл (ml) (50 мкл (μl)) ферментного реагенту Вітаміну B12 в кожну лунку. Додавати точно зверху на внесені в лунки реагенти.
- Добре перемішайте мікропланшет протягом 20-30 секунд.
- Накрійте мікропланшет і інкубуйте 30 хвилин при кімнатній температурі.
- Видаліть вміст лунок декантацією або аспірацією. Висушіть планшет на фільтрувальному папері, якщо використовувалася декантація.
- Додайте 350 мкл (μl) промивного буфера (див. розділ «Приготування реагентів») і видаліть його. Повторіть процедуру ще два рази (загальна кількість циклів промивки - 3). Для цієї процедури краще використовувати автоматичний або ручний вощер відповідно до інструкції виробника приладів. Якщо використовується пляшка під тиском, наповнити кожну лунку до верху (унікайте повітряних бульбашок). Видаліть розчин і повторіть 2 додаткових рази.
- Додайте по 100 мкл (μl) Робочого розчину субстрату в кожну лунку (див. «Приготування реагентів»). Завжди додавайте реагенти в одній і тій же послідовності і з однаковою швидкістю, щоб уникнути відмінностей у часі реакції в різних лунках.

НЕ СТРУШУЙТЕ ПЛАНШЕТ ПІСЛЯ ДОДАВАННЯ СУБСТРАТУ

- Інкубуйте 20 хвилин при кімнатній температурі.
- Зупиніть розвиток забарвлення додаванням в кожну лунку 50 мкл (μl) стоп-розчину і перемішайте протягом 15-20 секунд. Завжди додавайте реагенти в одній і тій же послідовності і з однаковою швидкістю, щоб уникнути відмінностей у часі реакції в різних лунках.
- Виміряйте величини поглинання вмісту лунок на довжині хвилі 450 нм (nm) (вимірювання проводити при референтній довжині хвилі 620-630 нм (nm)). Виміри повинні бути проведені протягом 15 хвилин після додавання стоп-розчину.

Примітка 3: Розвести зразки з концентраціями вище 2000 пг/мл (pg/ml) 1:5 або 1:10 '0' Калібратором і знову проаналізувати.

10.0 РЕЗУЛЬТАТИ

Для визначення концентрації відповідного маркера в невідомих зразках використовується калібрувальна крива.


- Запишіть значення оптичної щільноті для всіх лунок як показано в прикладі 1 та прикладі 2.
- Для побудови калібрувальної кривої на лінійному графічному папері використовуйте кожну з двох оптичних густин для кожного стандарту залежно від концентрації відповідного маркера в зазначених одиницях (не розрахуйте середнє значення до побудови).
- Проведіть оптимальну калібрувальну криву.
- Для визначення концентрації відповідного маркера в невідомих зразках знайти середній абсорбцію дублікатів для кожного невідомого на вертикальній осі графіка, знайти точку перетину з кривою і концентрацію (в нг/мл (ng/ml)) з горизонтальної вісі графіка (дублікати невідомих зразків можуть бути усереднені).

Примітка: Якщо програмне забезпечення використовується, перевірка програмного забезпечення повинна бути встановлена.

*Дані, малюнки і таблиці нижче призначенні тільки для прикладу. Не використовуйте їх для розрахунку результатів.

Приклад 1 - Фолат

Зразок	Лунка	Абсорбція (A)	Середнє абсорбції (B)	Концентрація (пг/мл (pg/ml))
Калібратор A	A1	2.812	2.839	0
	B1	2.865		
Калібратор B	C1	2.437	2.455	2.5
	D1	2.473		
Калібратор C	E1	2.058	2.055	5
	F1	2.051		
Калібратор D	G1	1.542	1.518	5
	H1	1.494		
Калібратор E	A2	1.003	1.015	10
	B2	1.027		
Калібратор F	C2	0.453	0.485	25
	D2	0.516		
Зразок	E2	1.004	1.021	11.9
	F2	1.038		

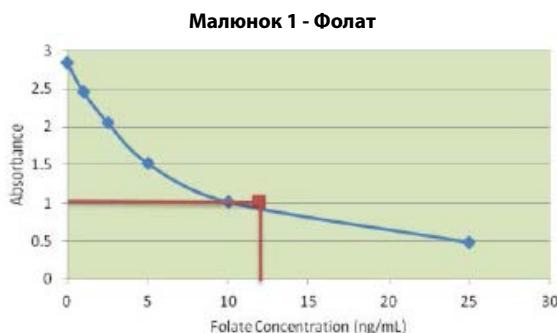


Absorbance - Абсорбція
Folate Concentration (ng/ml) - Концентрація Фолату (нг/мл)

Приклад 2 - Вітамін B12

Зразок	Лунка	Абсорбція (A)	Середнє абсорбції (B)	Концентрація (пг/мл (pg/ml))
Калібратор A	A1	2.475	2.457	0
	B1	2.438		
Калібратор B	C1	2.153	2.106	125
	D1	2.059		
Калібратор C	E1	1.819	1.792	250
	F1	1.764		
Калібратор D	G1	1.351	1.316	500
	H1	1.28		
Калібратор E	A2	0.828	0.803	1000
	B2	0.778		
Калібратор F	C2	0.236	0.231	2500
	D2	0.225		
Зразок	E2	1.052	1.087	680.5
	F2	1.122		

Малюнок 2 - Вітамін B12

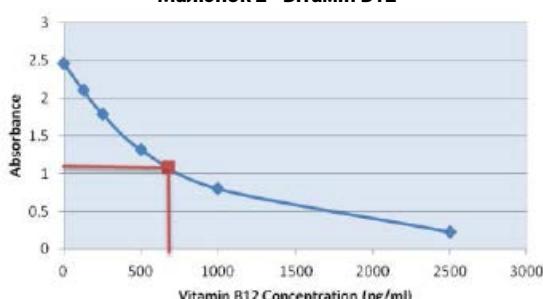

Absorbance - Абсорбція
Vitamin B12 Concentration (pg/ml) - Концентрація Вітаміну B12 (пг/мл)

11.0 ПАРАМЕТРИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТИ

Результати аналізу можна вважати достовірними, якщо дотримуються наступні умови:

- Оптична щільність калібратора 0 пг/мл (pg/ml) ≥ 1.8 .
- Чотири з шести контролів якості повинні укладатися у встановлені інтервали.

12.0 АНАЛІЗ РИЗИКІВ

MSDS та Форма Аналізу Ризиків для даного продукту доступні за запитом від Monobind Inc.

12.1 Якість роботи набору

- Для відтворюваності результатів важливо, щоб час реакції підтримувався постійним в кожній лунці.
- Піпетування зразків не повинно перевищувати 10 хвилин.
- Не використовувати високо ліпемічні, гемолізовані або забруднені зразки.
- Якщо використовується більше, ніж один планшет, рекомендується повторювати калібрувальну криву.
- Додавання субстратного розчину ініціює кінетичну реакцію, яка зупиняється при додаванні стоп-розчину. Отже, додавання субстрату і стоп-розчину повинно проводитися в однаковій послідовності для усунення відмінностей у часі реакції в різних лунках.
- Вимірювання оптичної щільності на рідері проходить вертикально. Не торкайтесь до дна мікролунок.
- Погана промивка лунок (неповне видалення розчину під час аспірації) може призводити до не відтворюваних і недостовірних результатів.

- Використовуйте компоненти тільки з одного лота. Не змішуйте реагенти з різних партій.
- Правильне і точне піпетування, а також дотримання точного часу і температурних вимог є необхідними умовами. Будь-які відхилення від встановлених Monobind можуть давати невірні результати.
- Дотримуватись всіх встановлених норм роботи лабораторної практики для забезпечення нормальної роботи пристрою.
- Важливим є калібрування всього обладнання, тобто, піpetok, рідера, вощера та/або автоматизованих інструментів, які використовуються з даним пристроєм. Також обов'язковим є належний догляд і обслуговування пристрою.
- Аналіз ризиків відповідно до вимог Директиви 98/79/EC IVD щодо цього та інших пристрій, виготовлених Monobind, можна надіслати електронною поштою на адресу Monobind@monobind.com.

12.2 Інтерпретація результатів

- Вимірювання та інтерпретація результатів повинні бути виконані кваліфікованим навченим професіоналом.**
- Лабораторні результати не можуть бути єдиним критерієм для визначення лікування, особливо, якщо отримані результати не співпадають з іншими дослідженнями.
- Реагенти для процедури випробувань системи були розроблені для максимального усунення перешкод; однак, потенційні взаємодії між деякими зразками сироватки і реагентами можуть привести до помилкових результатів. Гетерофільні антитіла часто викликають ці взаємодії і, як відомо, можуть стати проблемою для всіх видів імуноаналізу. Для діагностичних цілей, результати цього аналізу повинні бути використані в поєднанні з клінічним обстеженням, анамнезом пацієнта і всіма іншими клінічними даними.
- Для отримання дійсних результатів адекватні контролі та інші параметри повинні знаходитись в межах встановлених норм.
- Monobind не несе відповідальності за результати тесту в разі, якщо складові набору були замінені іншими складовими з інших наборів, або якщо результати були інтерпретовані невірно.
- Якщо для обробки результатів тесту використовується комп'ютер, то розраховані значення стандартів не повинні відхилятися більш, ніж на 10% від приписаних значень концентрації.

13.0 ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ

Відповідно до встановлених референсних інтервалів для «нормальної» популяції очікувані діапазони для даної тестової системи детально викладені в таблицях 1 і 2.

Таблиця 2

Очікувані значення для Фолату

Нормальне доросле населення > 3.0 нг/мл (ng/ml)

Таблиця 1

Очікувані значення для Вітаміну B-12

Населення	пг/мл (pg/ml)	пмоль/л (pmol/l)
Новонароджені	160 - 1300	118 - 959
Дорослі	200 - 835	148 - 616
Дорослі > 60 років	110 - 800	81 - 590

Важливо мати на увазі, що встановлений діапазон значень, який можна очікувати у даної популяції «нормальних» людей з використанням даного методу, залежить від безлічі факторів: специфічності методу, популяції, яка тестиється, і точності методу в руках лаборанта. З цих причин кожна лабораторія повинна встановити свій власний діапазон нормальних значень.

14.0 ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРУ

14.1 Точність

Точність набору всередині серії і між серіями тестової системи для визначення Фолату визначалася в аналізі пулів сироваток трьох різних рівнів. Кількість (N), середнє значення (x), стандартне відхилення (δ) і коефіцієнт вариації (C.V.) для цих сироваток наведені в таблицях 3 і 4.

ТАБЛИЦЯ 3

Точність в аналізі (нг/мл (ng/ml))

Зразок	N	x	δ	C.V., %
Рівень 1	24	3.72	0.31	8.3
Рівень 2	24	9.26	0.53	5.7
Рівень 3	24	13.71	0.83	6.1

ТАБЛИЦЯ 4

Точність між аналізами (нг/мл (ng/ml))

Зразок	N	x	δ	C.V., %
Рівень 1	12	3.32	0.32	9.6
Рівень 2	12	8.85	0.68	7.7
Рівень 3	12	12.85	1.15	8.9

*вимірювання проводились в 10 постановках в дублях протягом 10 днів.

Точність набору всередині серії і між серіями тестової системи для визначення Вітаміну B12 визначалася в аналізі пулів сироваток трьох різних рівнів. Кількість (N), середнє значення (x), стандартне відхилення (δ) і коефіцієнт варіації (C.V.) для цих сироваток наведені в таблицях 5 і 6.

ТАБЛИЦЯ 5

Точність в аналізі (пг/мл (pg/ml))

Зразок	N	x	δ	C.V., %
Низький	20	334.8	24.3	7.3 %
Нормальний	20	484.9	17.6	3.6 %
Високий	20	925.3	28.3	3.1 %

ТАБЛИЦЯ 6

Точність між аналізами (пг/мл (pg/ml))

Зразок	N	x	δ	C.V., %
Низький	18	314.9	49.4	15.7%
Нормальний	18	441.3	46.7	10.6%
Високий	18	913.1	39.4	4.8%

*вимірювання проводились в 10 постановках в дублях протягом 10 днів.

14.2 Чутливість

Тестова Система має чутливість для різних аналітів, які перераховані в наступній таблиці 7. Чутливість (межа визначення) визначена статистично як концентрація, відповідна значенню оптичної щільноті нульового стандарту 0 пг/мл (pg/ml) плюс 2σ (σ - Стандартне відхилення) при 95% довірчому інтервалі.

ТАБЛИЦЯ 7

Аналіт	Чутливість
Фолат	0.52 нг/мл (ng/ml)
Вітамін B12	70.13 пг/мл (pg/ml)

14.3 Достовірність

Тест-систему Фолат AccuBind® ІФА порівнювали з референсним методом. Біологічні зразки були використані зі значеннями, які варіювалися від 3.2 нг/мл (ng/ml) до 13.7 нг/мл (ng/ml). Загальна кількість таких зразків становить 30. Рівняння регресії найменших квадратів і коефіцієнт кореляції були розраховані для ІФА для визначення фолієвої кислоти в порівнянні з референсним методом. Отримані дані представлені в таблиці 8.

ТАБЛИЦЯ 8 - Фолат

Метод	Середнє (x)	Рівняння регресії	Коефіцієнт кореляції
Даний метод (Y)	7.76	y=0.162+1.07x	0.984
Метод порівняння (X)	8.46		

Тестова система для визначення Вітаміну B12 порівнювалась з затвердженим референтним методом. Використовувалися зразки з низьким, середнім і високим вмістом вітаміну B-12 (діапазон значень 156-1830 пг/мл (pg/ml)). Загальна кількість зразків була 56. Було виведено рівняння лінійної регресії і був розрахований коефіцієнт кореляції для даного методу в порівнянні з референсним методом. Отримані дані наведені в таблиці 9.

ТАБЛИЦЯ 9 - Вітамін B12

Метод	Середнє (x)	Рівняння регресії	Коефіцієнт кореляції
Даний метод (Y)	654.3	y=1.0186x - 48.82	0.951
Метод порівняння (X)	690.2		

Тільки незначна розбіжність даного методу і референс-методу була виявлена, що доводить близькі середні значення. Рівняння регресії і коефіцієнт кореляції показують прекрасну узгодженість методів.

14.4 Специфічність

Специфічність зв'язуючого білка фолієвої кислоти, використовуваної для обраних речовин, оцінювалася шляхом додавання додаткових речовин в матрицю сироватки в різних концентраціях.

ТАБЛИЦЯ 10 - Фолат

Субстанція Інтерференція

Білірубін	*ND
Біотин	*ND
Ліпемія	*ND

*ND = Не виявляється

Перехресні реакції антитіл до Вітаміну B-12 з різними речовинами оцінювалися додаванням інтерферуючих речовин в сироватку в різних концентраціях. Крос-реактивність розраховувалася як відношення між дозою інтерферуючої речовини і дозою вітаміну B-12, необхідного для заміщення цієї кількості речовини.

ТАБЛИЦЯ 11 - Вітамін B12

Речовина	Перехресна реактивність
Білірубін	0.0003
Ревматоїдний фактор	0.0008
Кобінамід	< 0.0001
Ліпемія	< 0.0001
Гемоглобін	< 0.0001

ВИРОБНИК

 МОНОБАЙНД ІНК
100 North Pointe Dr.
Lake Forest, CA 92630 - USA
Phone: 949.951.2665
Fax: 949.951.3539
www.monobind.com

МОНОБАЙНД ІНК
100 Норд Поінт Драйв
Лейк Форест, Каліфорнія 92630 - США
Tel.: 949.951.2665
Факс: 949.951.3539
www.monobind.com

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

