

 DAC-SPECTROMED S.R.L. МД-2012, Молдова, г. Кишинев, ул. Армянская, 47, кв. 64 Тел.: +37322/574900, 574922/23; факс: +37322/574920 Email: office@dacspectromed.com www.dacspectromed.com	HBeAg-S-Card-DAC Код 4173HBe1 1 тест	РТ MD 11-15796482-005:2006 Только для диагностики «in vitro» Хранить при 18-30°C
Одноэтапный тест-картридж для определения HBeAg в сыворотке		

ВВЕДЕНИЕ

HBeAg-S-Card-DAC является экспресс тестом прямого связывания для визуального определения в сыворотке антигена вируса гепатита Ве (HBeAg) при диагностике гепатита В.

Одноэтапный тест основан на принципе иммунологического анализа сэндвичевого типа. Для специфического определения HBeAg используются моноклональные и поликлональные антитела (иммуноглобулины).

Чувствительность теста – 2 ng/ml.

Данный одноэтапный тест занимает по времени около 10-30 минут.

Результаты теста считаются визуально без помощи прибора.

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Индивидуально упакованный тест-картридж с влагопоглотителем и пластиковой пипеткой.
- Инструкция

СБОР ПРОБ


Для получения сыворотки следует собрать кровь в контейнер без антикоагулянта. Оставьте кровь сворачиваться и отделите сыворотку из сгустка. Сыворотку используйте для тестирования.

Если тестирование пробы не может быть произведено в тот же день, храните пробу в холодильнике или морозильнике. Перед тестированием доведите пробы до комнатной температуры.

Не следует повторно замораживать и размораживать пробы.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

- Перед началом тестирования откройте упаковку, надорвав по отметке. Извлеките тест из упаковки и установите на ровную чистую поверхность.
- Наберите 0,20 мл (около 4 капель) образца в пипетку, и добавьте их в лунку для образца на картриdge.
- Инкубируйте 10-20 минут и считайте результат. Не считывайте результат спустя 30 минут.

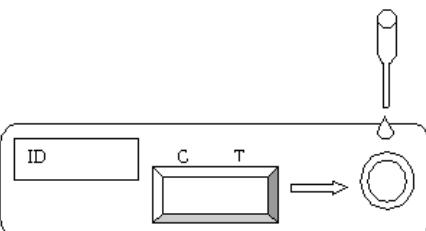

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

- Negative (отрицательный):** появляется только цветная полоса на контрольном участке. На тестовом участке видимая полоса отсутствует.
- Positive (положительный):** в дополнение к контрольной полосе розового цвета появляется четкая розовая полоса на тестовом участке.
- Invalid (недействительный):** полное отсутствие окрашивания на обоих участках является признаком ошибки в процедуре тестирования и/или порчи реагента.



ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Тест-набор следует хранить при комнатной температуре (18-30°C) в запечатанной упаковке до истечения срока годности. Тест-набор следует оберегать от прямых солнечных лучей, влажности и тепла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Только для диагностики *in vitro*.
- Не использовать набор после истечения срока годности.
- Тест-устройство не следует использовать повторно.