

ВІЛ 1/2/О, ОДНОРАЗОВА ТЕСТ-КАСЕТА ДЛЯ ШВИДКОЇ ДІАГНОСТИКИ

Кат. № : LUA-RT.HIVSU.C
Форма : касета

Упаковка: 1 тест
Дата останнього перегляду
інструкції: 01-02-2024

Тільки для використання в *in-vitro* діагностиці

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

Одноразова тест-касета для швидкої діагностики ВІЛ 1/2/О (цільна кров/сироватка/плазма) - це швидкий хроматографічний імуноаналіз для якісного виявлення антитіл до ВІЛ типу 1 та 2 та підтипу О в цільній крові, сироватці або плазмі з метою діагностики ВІЛ-інфекції.

РЕЗЮМЕ

ВІЛ (Вірус імунодефіциту людини) є етіологічним агентом Синдрому Набутого Імунодефіциту (СНІД). Віріон покритий ліпідною оболонкою, яка походить від мембраниої клітини організму-носія. Деякі віруси глікопротеїни знаходяться на оболонці. Кожен вірус містить дві копії позитивно-полярних геномних РНК. ВІЛ-1 був виділений у пацієнтів зі СНІДом та СНІД-пов'язаним комплексом, а також від здорових людей, які мають високий потенціал ризику розвитку СНІДу. ВІЛ-1 складається з підтипу М та підтипу О. Штами ВІЛ-1 спочатку були визначені в 1990-му році та згруповані тимчасово як підтип О, оскільки цей варіант має аналогічні маркери глікопротеїну до ВІЛ-1, але невелике відхилення від маркера білка. Незважаючи на дуже нечасті порівняно з ВІЛ-1 та ВІЛ-2, інфекції, викликані підтипом О, вони досі виявляються в Африці (Камерун), Франції та Німеччині. ВІЛ-2 був виділений у пацієнтів із Західноафриканським СНІДом та від серопозитивних безсимптомних осіб. Як ВІЛ-1, ВІЛ-2 так і підтип О викликають імунну реакцію. Виявлення антитіл до ВІЛ у сироватці, плазмі або цільній крові є найбільш ефективним та поширенішим способом визначення того, чи була людина інфікована ВІЛ, а також для скринінгу крові та продуктів крові на ВІЛ. Незважаючи на відмінності в їх біологічних характеристиках, серологічні активності і послідовності геномів, ВІЛ-1, ВІЛ-2 і підтип О демонструють сильну антигенну перехресну реакцію. Більшість позитивних на ВІЛ-2 сироваток можна ідентифікувати за допомогою серологічних тестів на базі ВІЛ-1.

Тест-касета на ВІЛ-1.2.О (цильна кров/сироватка/плазма) - це тест-касета для якісного визначення наявності антитіл до ВІЛ-1, ВІЛ-2 та/або підтипу О в цільній крові, сироватці або плазмі.

ПРИНЦІП

Одноразова тест-касета для швидкої діагностики ВІЛ 1/2/О (цильна кров/сироватка/плазма) - це якісний мембраний імуноаналіз для виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та підтипу О в цільній крові, сироватці або плазмі. Мембрана попередньо покрита рекомбінантними антигенами ВІЛ в області тестових ліній, T1 і T2. Тестова лінія T1 попередньо покрита антигеном ВІЛ-1 та підтипу О, а тестова лінія T2 попередньо покрита антигеном ВІЛ-2. Під час тестування зразок сироватки або плазми реагує з нанесеними на тест-смужці частинками антигена ВІЛ. Потім суміш мігрує вгору по мембрані хроматографічно за допомогою капілярної дії та реагує з рекомбінантним антигеном ВІЛ на мембрані в області тестової лінії. Якщо у зразку містяться антитіла до ВІЛ-1 та/або ВІЛ-2, в області тестової лінії з'являється кольорова лінія, що свідчить про позитивний результат. Якщо зразок не містить антитіл проти ВІЛ-1, підтипу О та/або ВІЛ-2, в області тестової лінії не з'явиться кольорова лінія, що вказує на негативний результат. В якості процедурного контролю кольорова лінія завжди з'являється в області контрольної лінії, що вказує на те, що був доданий відповідний об'єм зразка та відбулось зволоження мембрани.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Тільки для професійного застосування в *in vitro* діагностиці. Не використовувати після закінчення терміну придатності.
- Перед виконанням тесту слід повністю ознайомитися з цією інструкцією.
- Тест повинен залишатись у закритому пакеті до початку використання.
- Перед використанням привести всі реагенти до кімнатної температури (15-30 °C (°F)).
- Належним чином поводьтеся зі зразками і тест-пристроїми, що були використані, а саме так, ніби вони здатні потенційно інфіковувати. Утилізуйте всі зразки і використані пристрої в належному контейнері для біонебезпечних матеріалів. При обробці та утилізації небезпечних матеріалів слідуйте місцевим, національним або регіональним нормативним актам.

- Одягайте одноразові рукавички, халат та захисні окуляри під час обробки потенційно інфікованого матеріалу та виконання аналізу. Після цього ретельно вимийте руки.
- Недотримання температурного режиму може негативно вплинути на отримані результати.
- Не їсти, не пити і не палити в місцях, де працюють зі зразками і наборами.
- При розливанні зразків на будь-які поверхні потрібно ретельно прибрati, використовуючи відповідний дезінфікуючий засіб.
- Зберігати в недоступному для дітей місці.


ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

Зберігати набір при кімнатній температурі або в холодильнику (2-30 °C (°F)). Тест стабільний протягом усього терміну придатності, зазначеного на герметичній упаковці. Тест повинен залишатися в цьому мішечку до використання. **НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!** Не використовувати після закінчення терміну придатності.

МАТЕРІАЛИ

У маленькому пакеті міститься:


- Тест-касета
- Буфер
- Стерильний ланцет
- Спиртовий тампон
- Одноразову піpetку
- Інструкцію
- Лейкопластір



ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ

До початку тестування дозволити тест-касеті, зразку, буферу і/або контролям досягти кімнатної температури (15-30 °C (°F)).

Відкрийте маленький пакет, витягніть тест-касету та покладіть її на чисту та рівну поверхню. Найкращі результати будуть отримані, якщо аналіз буде виконано протягом однієї години.

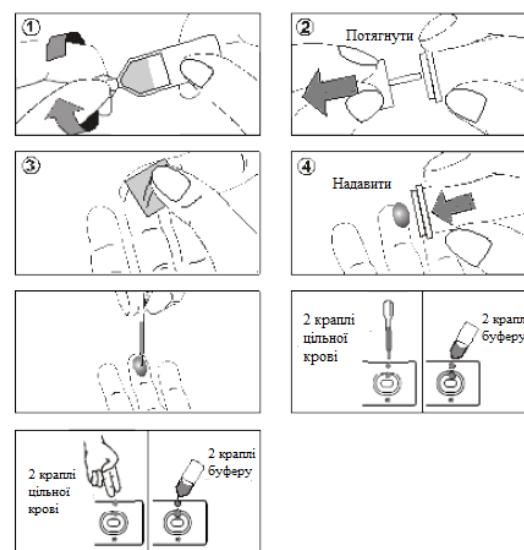

- Відкрийте великий пакет, витягніть флакон з буфером, стерильний ланцет та інші матеріали. Не натискаючи, відкрутіть вкладку буферного флакону. Потім покладіть його на чисту і рівну поверхню.
- Обережно зніміть кришку стерильного ланцета.
- Використовуйте наданий спиртовий тампон для очищення місця проколу.
- Проколіть стерильним ланцетом підготовлене місце. Дозвольте в місці проколу утворитись великий краплі вільної крові. Щоб збільшити кровообіг, великим та вказівним пальцями м'яко натисніть навколо ділянки проколу.
- Додайте зразок крові до тестової касети, використовуючи одноразову піpetку, що входить до складу великого пакета або за допомогою висячих крапель.

Використовуючи одноразову піpetку:

Тримайте піpetку вертикально, аспіруйте кров з місця проколу і додайте **две краплі цільної крові** з піpetки в лунку для зразка (S) на тестовій касеті, потім додайте **2 краплі буфера** і запустіть таймер. Уникайте торкання піpetки безпосередньо до пальця.

АБО

Використовуючи висячі краплі:

Переверніть руку і дозвольте **2 краплям цільної крові** впасті в центр лунки (S) тест-касети. НЕ ТОРКАЙТЕСЬ ЛУНКИ ДЛЯ ЗРАЗКА ПАЛЬЦЕМ. Потім додайте **2 краплі буфера** в лунку для зразка (S) і запустіть таймер.

- Дочекайтесь появи кольорових ліній. Прочитайте результати за 10 хвилин. Не інтерпретуйте результати через 20 хвилин.

ПРИМІТКА: Цей тест можна також проводити із зразками сироватки/плазми відповідно до наведених нижче інструкцій: додайте **1 краплю сироватки або плазми (приблизно 25 мкл (μl))** в лунку для зразка (S) тест-касети, потім додайте **1 краплю буфера**, і запустіть таймер. Зчитайте результати за 10 хвилин. Не інтерпретуйте результати через 20 хвилин.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

 Позитивний	ПОЗИТИВНИЙ З'являється дві чи три чіткі кольорові лінії. Одна лінія повинна завжди з'являтись в області контрольної лінії (C), а в зоні тестової лінії (T1 або T2) повинна з'явитися інша одна або дві видимі кольорові лінії. Інтенсивність кольору в області тестової лінії (T1 і T2) буде варіюватись в залежності від концентрації антитіл до ВІЛ, присутніх у зразку. Тому будь-який відтінок кольору в області тестової лінії (T1 або T2) слід вважати позитивним.
 Негативний	НЕГАТИВНИЙ У контрольній області (C) з'являється одна кольорова лінія. У області тестової лінії (T1 і T2) не з'являються видимі кольорові лінії.
 Недійсний	НЕДІЙСНИЙ Контрольна лінія не з'являється. Недостатній об'єм зразка або неправильна методика процедури тесту є найбільш ймовірними причинами не появі контольної лінії. Переглянути процедуру і повторити тест з використанням нової тест-касети. Якщо це не дає бажаного результату, слід припинити використання тестового набору негайно і зв'язатися з регіональним дистрибутором.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Внутрішні процедурні контролі включені в тест. Кольорова лінія, що з'являється на контрольній ділянці (C), є внутрішнім позитивним процедурним контролем. Вона підтверджує додавання належної кількості зразка, відповідне звложение мембрани і коректність проведення процедури.

Контрольні стандарти не поставляються разом з цим набором; тим не менш, належною лабораторною практикою рекомендується тестування позитивного і негативного контролів для підтвердження процедури тесту і контролю належної роботи тесту.

ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ

- Цей тест призначений тільки для діагностики *in vitro*. Цей тест був розроблений тільки для тестування зразків цільної крові/сироватки/плазми. Ні кількісне значення, ні рівень концентрації антитіл ВІЛ не можуть бути визначені цим якісним тестом.
- Одноразова тест-касета для швидкої діагностики ВІЛ 1/2/O лише покаже наявність антитіл до ВІЛ у зразку та не повинен використовуватися як єдиний критерій діагностики ВІЛ.
- Для підтвердження подальший аналіз зразків слід проводити згідно з рекомендаціями органів місцевого самоврядування, за допомогою ІФА або блотингу.
- Як і у всіх діагностичних тестах, всі результати повинні бути розглянуті разом з іншою клінічною інформацією, доступною для лікаря.
- Цей тест призначений тільки для цілей скринінгу. Результати не повинні використовуватися для визначення серотипу ВІЛ інфекції.
- Через можливу перехресну реакцію, поява ліній як T1, так і T2 не обов'язково свідчить про змішану інфекцію з ВІЛ-1, ВІЛ-2 та підтипу O.
- Якщо результат тесту є негативним і клінічні симптоми зберігаються, рекомендується провести додатковий аналіз за іншими клінічними методами. Негативний результат не включає можливості інфікування ВІЛ.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Одноразова тест-касета для швидкої діагностики ВІЛ 1/2/O (цільна кров/сироватка/плазма) порівнювалась з провідним комерційним ІФА тестом. Кореляція між цими двома системами становить 99.9%.

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чутливість і специфічність

Одноразовою тест-касетою для швидкої діагностики ВІЛ 1/2/O (цільна кров/сироватка/плазма) було правильно ідентифіковано зразки сероконверсійної панелі та цей тест порівнювався з провідним комерційним тестом на ВІЛ-інфекцію з використанням клінічних зразків. Результати показують, що відносна чутливість Одноразової тест-касети для швидкої діагностики ВІЛ 1/2/O (цільна кров/сироватка/плазма) становить > 99.9%, а відносна специфічність - 99.9%.

Метод	Інший Тест		Загальні результати
	Результати	Позитивний	
Одноразова тест-касета для швидкої діагностики ВІЛ 1/2/O (цільна кров/сироватка/плазма)	Позитивний	148	2
	Негативний	0	1728
	Загальні результати	148	1730
			1878

Відносна чутливість: > 99.9% (95%CI*: 98.0%-100%);

Відносна специфічність: 99.9% (95%CI*: 99.6%-100%);

Достовірність: 99.9% (95%CI*: 99.6%-100%).

*95% Довірчий інтервал

Точність В аналізі

Точність в аналізі визначалась за допомогою 15 дублікатів чотирьох різних зразків: негативний, низькопозитивний, середньопозитивний і високопозитивний. Негативні, низькопозитивні, середньопозитивні та високопозитивні значення були правильно ідентифіковані у >99% випадків.

Між аналізами

Точність між аналізами визначалась 15 незалежними аналізами на тих же чотирьох різних зразках: негативний, низькопозитивний, середньопозитивний і високопозитивний. Три різні партії Одноразової тест-касети для швидкої діагностики ВІЛ 1/2/O (цільна кров/сироватка/плазма) були протестовані протягом 3 місяців, використовуючи вище зазначені негативні та позитивні зразки. Зразки були правильно ідентифіковані у > 99% випадків.

Перехресна реактивність

Одноразова тест-касета для швидкої діагностики ВІЛ 1/2/O (цільна кров/сироватка/плазма) була протестована на позитивні зразки HAMA, РФ, HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, HCV, сифілісу, H. Pylori, мононуклеозу, CMV, краснуху та токсоплазми. Результати не показали перехресної реактивності.

Інтерферуючі речовини

Наступні потенційно інтерферуючі речовини були додані до негативних і позитивних зразків.

Ацетамінофен: 20 мг/дл (mg/dl)

Кофейн: 20 мг/дл (mg/dl)

Ацетилсаліцилова кислота: 20 мг/дл (mg/dl)

Гентизинова кислота: 20 мг/дл (mg/dl)

Аскорбінова кислота: 2 г/дл (g/dl)

Альбумін: 2 г/дл (g/dl)

Креатин: 200 мг/дл (mg/dl)

Гемоглобін: 1.1 мг/дл (mg/dl)

Білірубін: 1 г/дл (g/dl)

Щавлева кислота: 600 мг/дл (mg/dl).

Умовні позначення

	Увага, дивіться інструкції по застосуванню		Тестів в наборі		Не використовувати повторно
	Тільки для <i>in vitro</i> діагностики		Використати до		Кат. №
	Зберігати між 2-30 °C (°C)		№ партії		Зверніться до інструкції з використання
	Не використовуйте, якщо пакет пошкоджений		Виробник		

**ВИРОБНИК:**

ТОВ «ЛАБЮЕЙ»
вул. Петлюри, будинок 25,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна
Тел.: +380 (67) 000-20-22
Електронна адреса: info@labua.com.ua



UA.TR.116