

**НАБІР ІФА**

**ДЛЯ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ**  
**CCND1 В ТКАНИННИХ ГОМОГЕНАТАХ,**  
**КЛІТИННИХ ЛІЗАТАХ, СУПЕРНАТАНТАХ**  
**КЛІТИННИХ КУЛЬТУР І ІНШИХ БІОЛОГІЧНИХ**  
**РІДИНАХ ЛЮДИНИ**

**SEA585Hu, Cyclin D1 (CCND1)**

Кат. № : **SEA585Hu**      Версія 12  
 Кількість : **96**  
 Виробник : **Cloud-Clone Corp. (США)**



*Основово при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.*

**Тільки для використання в дослідницьких цілях та in-Vitro**  
**Не для використання в клінічних діагностичних процедурах**

**ПРИЗНАЧЕННЯ**

Даний набір є імуноферментним аналізом типу "сендвіч" для кількісного визначення CCND1 в гомогенатах тканин, клітинних лізатах, супернатантах клітинних культур та інших біологічних рідинах людини.

**РЕАГЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ, ЩО ПОСТАЧАЮТЬСЯ З НАБОРОМ**

Реагенти	Кількість
Готовий до використання, 96-лунковий смужковий планшет з попереднім покриттям	1
Стандарт	2
Реагент для детекції А	1 x 120 мкл
Реагент для детекції В	1 x 120 мкл
Субстрат ТМБ	1 x 9 мл
Промивний Буфер (30x Концентрат)	1 x 20 мл
Плівка для 96 лунок	4
Розчинник стандартів	1 x 20 мл
Робочий Розчинник А	1 x 12 мл
Робочий Розчинник В	1 x 12 мл
Стоп Розчин	1 x 6 мл
Інструкція	1

**НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ З НАБОРОМ**

- Мікропланшетний зчитувач з фільтром  $450 \pm 10$  нм.
- Точні одно- або багатоканальні піпетки та одноразові наконечники.
- Мікроцентрифужні пробірки.
- Деіонізована або дистильована вода.
- Фільтрувальний папір для промокання планшета.
- Контейнер для Промивного розчину.
- 0.01 моль/л (або 1x) PBS (рН 7.0-7.2).

**ЗБЕРІГАННЯ НАБОРІВ**

- Для нерозкритих наборів:** Всі реагенти повинні зберігатися згідно з інформацією, вказаною на флаконах. **Стандарт, Реагент для детекції А, Реагент для детекції В і планшет** повинні зберігатися при температурі  $-20^{\circ}\text{C}$  при отриманні, а інші повинні зберігатися при  $4^{\circ}\text{C}$ .
- Для відкритих наборів:** Після відкриття набору реагенти як і раніше повинні зберігатися відповідно до вищезазначених умов зберігання. Крім того, будь ласка, поверніть невикористані смужки в пластикову упаковку, яка містить осушувач, і щільно закройте її.

**Примітка:**

Рекомендується використовувати залишки реагентів протягом 1 місяця за умови, що не закінчився термін придатності набору. Термін придатності набору вказаний на етикетці на упаковці набору. Всі компоненти стабільні до закінчення терміну його дії.

**ЗАБІР І ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ**

**Гомогенати тканин:** Підготовка гомогенатів тканин варієється залежно від типу тканини.

- Тканини промивають в дуже охолодженному PBS, щоб видалити надлишок крові і ретельно зважують до гомогенізації.
- Подрібнюють тканини на дрібні шматочки і гомогенізувати їх в свіжому буфері для лізису (каталог: IS007, різні буфери для лізису повинні бути обрані на основі внутрішньоклітинної локалізації білка-мішени) ( $w:v = 1:20-1:50$ , наприклад, 1 мл буфера для лізису додають до 20-50 мг зразка тканини) зі скляним гомогенізатором на льоду (також Micro Tissue Grinders woks).
- Отриману суспензію обробляють з ультразвуковим руйнівним пристроєм, щоб отримати прозорий розчин.
- Після цього гомогенати центрифугують протягом 5 хвилин при 1000xg. Виділити супернатант та аналізувати негайно або підготувати аліквоти і зберігати при температурі  $\leq -20^{\circ}\text{C}$ .

**Клітинні лізати** - Клітини повинні бути лізовані перед аналізом у відповідності з наступними кроками.

- Адгезивні клітини повинні бути обережно промиті холодним PBS, а потім відокремлені трипсином і зібрані центрифугуванням при 1000xg протягом 5 хвилин (підвісні клітини можуть бути зібрані шляхом центрифугування безпосередньо).
- Вимийте клітини три рази в холодному PBS.
- Ресуспендувати клітини в свіжому буфері для лізису з концентрацією  $10^7$  клітин/мл. Якщо необхідно, ці клітини можуть бути піддані обробці ультразвуком, поки розчин не стане прозорим.
- Центрифугувати при 1500 xg протягом 10 хвилин при  $2-8^{\circ}\text{C}$  для виділення залишків клітин. Аналізувати негайно або аліквотувати і зберігати при  $\leq -20^{\circ}\text{C}$ .

**Супернатанти клітинні культури і інші біологічні рідини:**


Центрифугувати зразки протягом 20 хвилин при 1000xg. Зібрати супернатант та аналізувати негайно або зберігати зразки в аліквотах при  $-20^{\circ}\text{C}$  або при  $-80^{\circ}\text{C}$  для пізнішого використання. Уникайте повторних циклів заморожування/відтавання.

**Примітка:**

- Зразки, які будуть використані протягом 5 днів, можна зберігати при температурі  $4^{\circ}\text{C}$ , в іншому випадку зразки повинні зберігатися при температурі  $-20^{\circ}\text{C}$  ( $\leq 1$  місяць) або  $-80^{\circ}\text{C}$  ( $\leq 2$  місяці), щоб уникнути втрати біологічної активності та забруднення.
- Гемоліз зразка буде впливати на результат, тому гемолітичні зразки не повинні аналізуватися.
- При виконанні тесту привести зразки до кімнатної температури.

**ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ**

- Привести всі компоненти набору та зразки до кімнатної температури ( $18-25^{\circ}\text{C}$ ) перед використанням. Якщо набір не буде використаний за один раз, будь ласка, тільки вийміть смужки і реагенти для даного аналізу, і залишіть решту смужок і реагентів у відповідних умовах зберігання.
- Стандарт** - Відновити **Стандарт** з 1,0 мл **Розчинника стандарту**, який зберігається протягом 10 хвилин при кімнатній температурі, злегка потрусити (не до утворення піни). Концентрація стандарту в вихідному розчині 80 ng/ml. Будь ласка, спочатку розбавте вихідний розчин до 20 ng/ml, а розбавлений стандарт виступає як найвищий стандарт (20 ng/ml). Потім підготуйте 7 пробірок, що містять 0,5 мл **Розчинника Стандарту**, і проведіть подвійний ряд розбавлення відповідно з малюнком нижче. Перемішайте кожну пробірку ретельно перед наступним переміщенням. Налаштуйте 7 розведень стандарту, наприклад 20 ng/ml, 10 ng/ml, 5 ng/ml, 2.5 ng/ml, 1.25 ng/ml, 0.625 ng/ml, 0.312 ng/ml, і остання пробірка ЕР з **Розчинником стандарту** є бланком 0 ng/ml.

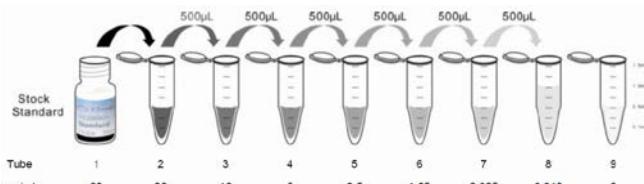

- Реагент детекції А і Реагент детекції В** – Центрифугувати Вихідний Розчин Детекції А та Вихідний Розчин Детекції В перед використанням. Розбавити робочий концентрат з робочим **Розчинником для аналізів А або В** відповідно (1:100).
- Промивний Розчин** – Розвести 20 мл концентрату Розчину для промивання (30x) з 580 мл деіонізованої або дистильованої води для отримання 600 мл Розчину для промивання (1x).

5. **Субстрат ТМВ** - Аспірувати необхідні дози розчину за допомогою стерилізованих наконечників і не повернати залишки розчину знову у флакон.

#### Примітка:

- Проведення серійних розведенів безпосередньо в лунках не допускається.
- Приготувати стандарт протягом 15 хвилин до аналізу. Будь ласка, не розчиняйте реагенти безпосередньо при 37 °C.
- Обережно відновити Стандарти або робочі Реагенти детекції А і В у відповідності з інструкцією, уникнути піноутворення, і акуратно перемішати, поки кристали повністю не розчиняться. Щоб звести до мінімуму неточності, пов'язані з піпетуванням, використовуйте невеликі обсяги і переконайтесь, що піпетки калібровані. Рекомендується набирати більше 10 мкл на одне піпетування.
- Відновлені Стандарти, Реагент детекції А та Реагент детекції В можуть бути **використані тільки один раз**.
- Якщо кристали утворилися в Концентраторі Розчину для промивання (30x), його необхідно нагріти до кімнатної температури і акуратно перемішати, поки кристали повністю не розчиняться.
- Забруднена вода або контейнер для приготування реагентів будуть впливати на результати аналізу.

#### ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ

- Корпорація Cloud-Clone несе відповідальність тільки за сам набір, але не за зразки, які використовуються в процесі аналізу. Користувач повинен розрахувати можливу кількість зразків, що використовуються в тесті. Будь ласка, приготуйте достатню кількість зразків заздалегідь.
- Будь ласка, розрахуйте концентрацію перед дослідженням. Якщо значення концентрацій не входять в діапазон значень стандартної кривої, користувач повинен визначити оптимальні розведення зразка для конкретного експерименту. Зразок слід розбавити PBS.
- Якщо зразки не вказані в інструкції, необхідно провести попередній експеримент по визначенням обґрунтованості використання набору.
- Екстракційні зразки тканин або клітин, приготовані за допомогою хімічного лізуючого буфера, можуть привести до несподіваних результатів ELISA через вплив деяких хімічних речовин.
- У зв'язку з можливістю розбіжності між антигеном іншого походження і антитілом, використовуваним в даному наборі, деякі нативні або рекомбінантні білки від інших виробників можуть не працювати з даним набором.
- Під впливом факторів, таких як життєздатність клітин, число клітин або час тестування зразків, зразки супернатанту культури клітин можуть бути не виявлені за допомогою набору.
- Для тестування рекомендується використовувати свіжі зразки без тривалого зберігання. В іншому випадку, деградація білків і денатурація можуть відбутися в цих зразках, що приведе до невірних результатів.

#### ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ

- Визначити кількість лунок для розбавленого стандарту, бланка і зразка. Підготувати 7 лунок для стандарту, 1 лунку для бланка. Додати 100 мкл кожного з розведенів стандарту (читайте про підготовку реагентів), бланка і зразків у відповідні лунки. Накрити плівкою. Інкубувати протягом 1 години при 37 °C.
- Видалити рідину з кожної лунки, не мити.
- Додати 100 мкл робочого розчину **Реагенту для детекції А** в кожну лунку. Витримати протягом 1 години при 37 °C після покриття планшета плівкою.
- Аспірувати розчин і промити з використанням 350 мкл 1x Розчину для промивання на кожну лунку, застосовуючи пульверизатор, багатоканальну піпетку, розподільчу колбу або автопромивач, і залишити на 1~2 хвилини. Видалити залишки рідини з лунок повністю, постукавши пластиною на фільтрувальний папір. Промити 3 рази. Після останньої промивки видалити залишки промивного буфера шляхом аспірації або декантування. Перефернути планшет і промокнути його фільтрувальним папером.
- Додати 100 мкл робочого розчину **Реагенту для детекції В** в кожну лунку. Витримати протягом 30 хвилин при 37 °C після покриття планшета плівкою.
- Повторити процес аспірації/промивання всього 5 разів, як описано в кроці 4.
- Додати 90 мкл **Розчину субстрату** в кожну лунку. Покрити новою плівкою. Інкубувати протягом 10-20 хвилин при 37 °C (не більше 30 хвилин). Захищати від світла. Рідина стане синього кольору при додаванні розчину субстрату.
- Додати 50 мкл **Стоп розчину** в кожну лунку. Рідина стане жовтого кольору при додаванні Стоп розчину. Змішати рідину, постукуючи по

- стороні пластини. Якщо зміна кольору не відбувається, легко постукати по пластині, щоб забезпечити ретельне перемішування.
- Видалити всі краплі води і постукати по нижній частині пластини; впевнитися, що немає бульбашок на поверхні рідини. Потім запустити мікропланшетний читувач і провести вимірювання при 450 nm негайно.

#### Примітка:

- Підготовка до аналізу:** Приготуйте відповідну кількість лунок для кожного експерименту і заберіть зайві лунки з планшета. Лунки, які не використовуються, повинні зберігатися при температурі -20 °C.
- Додавання зразків або реагентів:** **Будь ласка, використовуйте свіжоприготовлений Стандарт.** Обережно додати зразки в лунки і акуратно перемішати, щоб уникнути піноутворення. Не торкатись стінок лунки. Для кожного етапу процедури загальний час дозування для додавання реагентів або зразків в планшет для аналізу не повинен перевищувати 10 хвилин. Це забезпечить рівномірний розподіл часу піпетування для кожного кроку, без переривання. Рекомендується дублювання всіх стандартів і зразків, хоча це є обов'язковим. Щоб уникнути перехресного забруднення, мініяйте наконечники піпеток між додаваннями стандартів, зразків і реагентів. Крім того, використовуйте окремі резервуари для кожного реагенту.
- Інкубація:** Для забезпечення точності результатів необхідне належне проведення герметизації планшета під час інкубації. Не допускайте, щоб лунки залишались відкритими на довший час між інкубаціями. Як тільки реагенти були додані в лунки, НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ смужкам ВИСИХАТИ в будь-який час під час тесту. Час інкубації і температура повинні контролюватися.
- Промивання:** Процедура промивання є критичною. Повне видалення рідини на кожній стадії має важливе значення для високої продуктивності. Після останньої промивки видалити залишки розчину для промивання шляхом аспірації або декантування і видалити всі краплі води постукуванням кінчиками пальців по нижній частині пластини. Недостатня промивка призводить до низької точності і помилкових підвищених результатів вимірювання.
- Контроль часу реакції:** Спостерігайте за зміною кольору після додавання субстрату ТМВ (наприклад, спостереження кожних 10 хвилин), якщо колір занадто насичений, додайте Стоп розчин заздалегідь, щоб уникнути надмірно сильної реакції, що призведе до неточності показань оптичної щільності.
- Субстрат ТМВ** легко забруднюється. Будь ласка, захищайте його від світла.
- Вологість навколошнього середовища, менша за 60 %, може вплинути на роботу, тому зволожувач повітря рекомендується використовувати в такому стані.

#### ПРИНЦІП ТЕСТУ

Мікропланшет, який входить до набору, був попередньо покритий антитілом, специфічним до CCND1. Стандарти та зразки додаються до відповідних лунок планшета з біотин-кон'югованими антитілами, специфічними до CCND1. Потім додається кон'югат авідин-HRP до кожної лунки мікропланшета і проводиться інкубація. Після додавання розчину субстрату ТМВ, тільки ті лунки, що містять CCND1, біотинільовані антитіла і фермент-кон'югований авідин, будуть демонструвати зміну в кольорі. Фермент-субстрат Реакція фермент-субстрат зупиняється додаванням розчину сірчаної кислоти і зміна кольору вимірюється спектрофотометрично на довжині хвилі 450 nm ± 10 nm. Концентрація CCND1 у зразках визначається шляхом порівняння OD зразків на стандартній кривій.


#### ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ

Визначити середнє значення в дублях для кожного стандарту, контролю і зразків і відняти середнє значення оптичної щільності нульового стандарту. Побудувати стандартизу криву, відкладаючи середнє OD і концентрації для кожного стандарту і провести кращий варіант кривої через точки на графіку або створити стандартизу криву на логарифмічному папері зі значеннями концентрації CCND1 на осі ординат і абсорбцією на осі абсцис. Використання програмного забезпечення, наприклад, Експерта кривої 1.30, також рекомендується. Якщо зразки були розбавлені, концентрацію, яка зчитується зі стандартної кривої, слід помножити на коефіцієнт розведення.

#### ТИПОВІ ДАНІ

Для того, щоб зробити розрахунок простішим, ми відкладаємо значення OD стандарти (X-вісь) проти відомої концентрації стандарти (Y-вісь), хоча концентрація є незалежною змінною і значення OD є залежною змінною. Тим не менш, значення OD стандартої кривої можуть мінятися залежно від умов аналізу (наприклад, оператора, техніки піпетування, техніки

промивки або температурних впливів). Рекомендується побудова стандартної кривої для кожного тесту. Типова стандартна крива, приведена нижче, призначена тільки для ознайомлення.

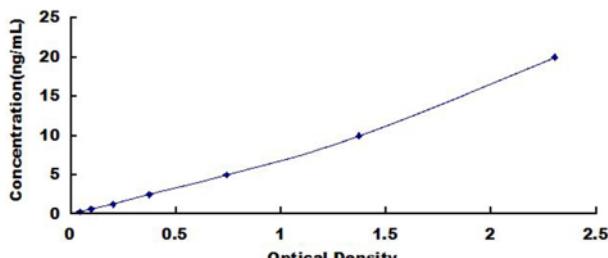

Типова стандартна крива для CCND1 людини, ELISA

#### ДІАПАЗОН ВИЯВЛЕННЯ

0.312-20 нг/мл. Концентрації Стандартної кривої, які використовувались для ELISA, були 20 нг/мл, 10 нг/мл, 5 нг/мл, 2.5 нг/мл, 1.25 нг/мл, 0.625 нг/мл, 0.312 нг/мл.

#### ЧУТЛИВІСТЬ

Мінімальна доза CCND1, яка визначається, типово є меншою за 0.113 нг/мл.

Чутливість даного аналізу, або Нижня Межа Виявлення (LLD), була визначена як найнижча концентрація протеїнів, більша за нуль. Вона була розрахована додаванням двох стандартних відхилень до значення середньої оптичної щільності 20 нульових стандартів, після чого була розрахована відповідна концентрація.

#### СПЕЦІФІЧНІСТЬ

Даний аналіз має високу чутливість та надзвичайну специфічність для виявлення CCND1.

Не спостерігалося значної перехресної активності або інтерференції між CCND1 і аналогами.

#### Примітка:

У зв'язку з обмеженням навичок та знань, неможливо для нас повністю завершити виявлення перехресної реактивності між CCND1 і всіма аналогами, тому перехресна реакція може все ще існувати.

#### ТОЧНІСТЬ

Точність в аналізі: З зразки з низьким, середнім і високим рівнем CCND1 були протестовані 20 разів на одному планшеті, відповідно.

Точність між аналізами: З зразки з низьким, середнім і високим рівнем CCND1 були протестовані на 3 різних планшетах, 8 повторів на кожному.

CV (%) = SD/середнє Х 100

В аналізі: CV < 10%

Між аналізами: CV < 12%

#### СТАБІЛЬНІСТЬ

Стабільність набору ІФА визначається швидкістю втрати активності. Швидкість зниження активності даного набору складає менше 5% протягом терміну придатності при відповідних умовах зберігання.

Щоб звести до мінімуму додатковий вплив на продуктивність, необхідно дотримуватися порядку проведення тесту і лабораторних умов, особливо кімнатної температури, вологості повітря, температури інкубатора, які мають суворо контролюватися. Крім того, рекомендується, щоб весь аналіз проводився одним і тим же оператором від початку і до кінця.

#### ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗРАЗКІВ

**Сироватка/плазма** - 21 зразок сироватки та плазми від здорових добровольців були оцінені в цьому аналізі. Всі вимірювані зразки мали значення, менші ніж найнижчий стандарт CCND1.

**Клітинні лізати** - Клітинні лізати приготовлені відповідно до протоколу, наведеного в розділі ЗБІР ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ, були оцінені для визначення рівня CCND1. Результати показані в таблиці нижче.

Зразки	Діапазон О.Д.
Клітини MCF-7	0.334-0.678
Клітини JAR	0.692-0.936

#### РЕЗЮМЕ ПРОЦЕДУРИ АНАЛІЗУ

- Підготувати всі реагенти, зразки і стандарти;
- Додати 100 мкл стандарта або зразка в кожну лунку. Інкубувати 1 годину при 37 °C;
- Аспірувати і додати 100 мкл підготовленого Реагенту Детекції A. Інкубувати 1 годину при 37 °C;

- Аспірувати і промити 3 рази;
- Додати 100 мкл підготовленого Реагенту Детекції B. Інкубувати 30 хвилин при 37 °C;
- Аспірувати і промити в 5 разів;
- Додати 90 мкл розчину субстрату. Витримати 10-20 хвилин при 37 °C;
- Додати 50 мкл стоп розчину. Зчитати при 450 нм негайно.

#### ЗАУВАЖЕННЯ

- Обмежені поточним станом та науковими технологіями, ми не можемо повністю провести всебічну ідентифікацію та аналіз сировини, яка надається постачальниками. Тому можуть існувати деякі якісні та технічні ризики при використанні набору.
- Остаточні результати аналізу будуть тісно пов'язані з якістю продукції, операційних навичок кінцевих користувачів і експериментальних умов. Будь ласка, переконайтесь, що достатня кількість зразків є доступною.
- Набори з різних партій може трохи відрізнятися за діапазоном виявлення, чутливості і часом розвитку забарвлення. Будь ласка, проводьте експеримент в точній відповідності до інструкції, яка додається в комплекті; електронні версії з нашого сайту є тільки інформаційними.
- Забороняється використовувати реагенти з наборів різних партій. Використовуйте тільки Реагенти, що поставляються виробником.
- Захищати всі реагенти від яскравого світла під час зберігання та інкубації. Всі пробки на пляшках з реагентами повинні бути щільно закритими, щоб запобігти випаровування і забруднення мікроорганізмами. Субстрат ТМБ повинен залишатись безбарвним, поки він не реагує з ферментом, який нанесений в лунки мікропланшету.
- При першому відкритті в лунках може знаходитись деяка речовина. Це не буде мати ніякого впливу на остаточні результати аналізу. Не виймайте мікротитраційний планшет з пакету, де він зберігається, поки це не є необхідним.
- Неправильне операціювання при підготовці реагентів та їх завантаженні, а також помилки в налаштуванні параметрів для планшетів можуть привести до невірних результатів. Мікропланшетний читувач з шириною доріжки 10 нм або менше і діапазоном оптичної щільності 0-3 O.D. або більше при довжині хвилі  $450 \pm 10$  нм є прийнятним для використання для вимірювання абсорбції. Будь ласка, прочитайте уважно інструкцію і налаштуйте пристрій до експерименту.
- Навіть один і той же оператор може отримати різні результати у двох окремих експериментах. Для того, щоб отримати кращу відтворюваність результатів, робота кожного кроку в аналізі повинна контролюватися. Крім того, рекомендується проведення попереднього експерименту перед аналізом для кожної партії.
- Кожен набір пройшов тест з Контролю якості. Тим не менш, результати від кінцевих користувачів можуть бути несумісними з нашими внутрішніми даними через деякі несподівані умови транспортування або різне устаткування лабораторії. Розбіжність між серіями серед комплектів з різних партій може виникнути в результаті цих факторів, теж.
- Набори від різних виробників можуть призводити до різних результатів, так як ми не порівнювали нашу продукцію з іншими виробниками.
- Стандарт набору та імуноген, використовувані для приготування антитіл, зазвичай є рекомбінантними білками, тому, при підготовці рекомбінантних білків, з різними фрагментами, різними способами очищення, ми не можемо гарантувати, що набір може виявити рекомбінантний білок виробництва інших компаній. Отже, не рекомендується використовувати набір для виявлення рекомбінантного білка.
- Прогнозуйте концентрацію молекул-мішень у зразках, або організуйте попередній експеримент; це є хороший спосіб вирішити конкретну проблему, наприклад конкретна концентрація зразків перевищує діапазон виявлення набору.
- Набір може бути непридатним для виявлення зразків з якогось спеціального експерименту, наприклад, експериментів з вибирання, через невизначеність їх ефективності.
- Інструкція також підходить для набору 48T, але всі реагенти набору 48T зменшені наполовину.
- Набір призначений тільки для використання *in vitro* та дослідницьких цілей, ми не будемо відповідальними за будь-яке питання, якщо набір використовувався в клінічній діагностиці або в будь-яких інших процедурах.

#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Стоп-розчин, запропонований для використання з цим набором, є розчином кислоти. Використовувати захист для очей, рук, обличчя при роботі з даним матеріалом.

## ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Проблема	Можливе джерело	Коригувальні дії
Погана Стандартна крива	Неправильна підготовка Стандартної кривої	Забезпечити точну роботу розбавлення взірця
	Неповна промивка та аспірація	Адекватні промивка та аспірація
	Неточне піпетування	Перевірити та калібрувати піпетки
Слабка точність	Незавершена промивка лунок	Забезпечити достатню промивку
	Недостатнє перемішування і аспірація реагентів	Адекватні аспірація і змішування реагентів
	Повторне використання піпеток, контейнерів та герметики	Змінити і використовувати нові наконечники, контейнери та герметику
	Неточне піпетування	Перевірити та калібрувати піпетки
Низькі значення O.D.	Недостатні обсяги реагенту, додані в лунки	Провести калібрування піпеток і додати адекватну кількість реагентів
	Невірний час інкубації	Забезпечити достатній час інкубації
	Невірна температура інкубації	Реагенти привести до кімнатної температури
	Не працює кон'югат або субстрат	Змішайте кон'югат і субстрат, колір повинен розвиватися негайно
	Не добавлено Стоп розчин	Дотримуйтесь протоколу аналізу
Значення зразків	Неправильне зберігання зразка	Зберігати зразки належним чином і використовувати свіжий зразок
	Невірні забір та підготовка зразків	Вибрати правильний метод забору зразків і їх підготовки
	Недостатня кількість аналіту у зразках	Використовуйте новий зразок і повторіть аналіз



ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

ТОВ «ДІАМЕБ»  
 вул. Чорновола, 97  
 м. Івано-Франківськ, 76005  
 тел.: +38 (0342) 775 122  
 факс: +38 (0342) 775 123  
 e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.com](http://www.diameb.com)