

НАБІР ІФА
ДЛЯ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ
КОАГУЛЯЦІЙНОГО ФАКТОРА VIII (F8)
В ПЛАЗМІ ЛЮДИНИ

SEB878Hu, F8

Каталог. №: **SEB878Hu**

Методика від **07-2013**

Кількість : **96**

Виробник : **Cloud-Clone Corp., (США)**



Основовою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

**Тільки для використання в дослідницьких цілях та in-Vitro
Не для використання в клінічних діагностичних процедурах**

ПРИЗНАЧЕННЯ

Даний набір є імуноферментним аналізом типу "сандвіч" для кількісного визначення Коагуляційного фактора VIII (F8) в плазмі людини.

РЕАГЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ, ЩО ПОСТАЧАЮТЬСЯ

Реагенти	Кількість
Готовий до використання, 96-лунковий смужковий планшет з попереднім покриттям	1
Стандарт	2
Реагент для детекції А	1 x 120 мкл
Реагент для детекції В	1 x 120 мкл
Субстрат ТМБ	1 x 9 мл
Промивний Буфер (30x Концентрат)	1 x 20 мл
Плівка для заклеювання планшетів	4
Розчинник стандартів	1 x 20 мл
Робочий Розчинник А	1 x 12 мл
Робочий Розчинник В	1 x 12 мл
Стоп Розчин	1 x 6 мл
Інструкція	1

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ

- Мікропланшетний читувач з фільтром 450±10 нм.
- Точні одно- або багатоканальні піпетки та одноразові наконечники.
- Пробірки Епендорфа для розбавлення зразків.
- Деіонізована або дистильована вода.
- Фільтрувальний папір для промокання планшета.
- Контейнер для Промивного розчину.

ЗБЕРІГАННЯ НАБОРІВ

- Для нерозкритих наборів:** Всі реагенти повинні зберігатися згідно з інформацією, вказаною на флаконах. **Стандарт, Реагент для детекції А, Реагент для детекції В і планшет** повинні зберігатися при температурі - 20 °C при отриманні, а інші повинні зберігатися при 4 °C.
- Для відкритих наборів:** після відкриття набору реагенти як і раніше повинні зберігатися відповідно до вищезазначених умов зберігання. Крім того, будь ласка, поверніть невикористані смужки в пластикову упаковку, яка містить осушувач, і щільно закрійте її.

Примітка:

Рекомендується використовувати залишки реагентів протягом 1 місяця за умови, що не закінчився термін придатності набору. Термін придатності набору вказаний на етикетці на упаковці набору. Всі компоненти стабільні до закінчення терміну його дії.

ЗАБІР І ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ


Плазма: Провести забір плазми з використанням 3,8% цитрат натрію (цитрат натрію: кров = 1:9) в якості антикоагулянту. Зразки центрифугуйте протягом 15 хвилин при 1000xg при 2-8 °C протягом 30 хвилин після збору. Видаліть плазму та аналізуйте негайно або зберігайте зразки в аліковатах при -20 °C або -80 °C для подальшого використання. Уникайте повторних циклів заморожування/розморожування.

Примітка:

- Зразки, які будуть використовуватися протягом 5 днів, можна зберігати при температурі 4 °C, в іншому випадку зразки повинні зберігатися при температурі -20 °C (≤ 1 місяць) або -80 °C (≤ 2 місяці), щоб уникнути втрати біологічної активності та забруднення.
- Гемоліз зразка буде впливати на результат, тому гемолітичні зразки не повинні аналізуватися.
- При виконанні тесту привести зразки до кімнатної температури.

ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТИВІВ

- Привести всі компоненти набору та зразки до кімнатної температури (18-25 °C) перед використанням.
- Стандарт** - Відновити **Стандарт** з 1,0 мл **Розчинника стандарту**, який зберігався протягом 10 хвилин при кімнатній температурі, злегка потрусити (не до утворення піни). Концентрація стандарту в вихідному розчині 10.000 pg/ml. Будь ласка, спочатку розбавте розчин до 5.000 pg/ml і розбавлений стандарт служить в якості самого високого стандарту (5.000 pg/ml). Будь ласка, підготуйте 7 пробірок, що містять 0,5 мл **Розчинника Стандарту**, і проведіть подвійний ряд розбавлення відповідно з малюнком нижче. Перемішайте кожну пробірку ретельно перед наступним переміщенням. Налаштуйте 7 розведені стандарти, наприклад 5.000 pg/ml, 2.500 pg/ml, 1.250 pg/ml, 625 pg/ml, 312 pg/ml, 156 pg/ml, 78 pg/ml, і остання пробірка ЕР з **Розчинником стандарту** є порожньою 0 pg/ml.

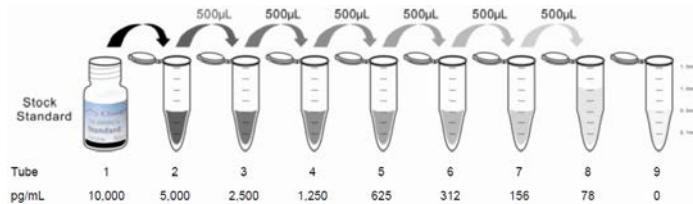

- Реагент детекції А і Реагент детекції В** – Центрифугувати Вихідний Розчин Детекції А та Вихідний Розчин Детекції В перед використанням. Розвабити робочий концентрат з робочим **Розчинником для аналізів А або В** відповідно (1:100).
- Промивний Розчин** - Розвести 20 мл концентрату Розчину для промивання (30x) з 580 мл діонізованої або дистильованої води для отримання 600 мл Розчину для промивання (1x).
- Субстрат ТМБ** - Аспірувати необхідні дози розчину за допомогою стерилізованих наконечників і не повертати залишки розчину знову у флакон.

Примітка:

- Проведення серійних розведенів безпосередньо в лунках не допускається.
- Приготувати стандарт протягом 15 хвилин до аналізу. Будь ласка, не розчиняйте реагенти безпосередньо при 37 °C.
- Обережно відновити Стандарти або робочі Реагенти детекції А і В відповідності з інструкцією, уникуючи піноутворення, і акуратно перемішати, поки кристали повністю не розчиняються. Щоб звести до мінімуму неточності, пов'язані з піпетуванням, використовуйте невеликі обсяги і переконайтесь, що піпетки калібровані. Рекомендується набирати більше 10 мкл на одне піпетування.
- Відновлені Стандарти, Реагент детекції А та Реагент детекції В можуть бути **використані тільки один раз**.
- Якщо кристали утворилися в Концентраті Розчину для промивання (30x), його необхідно нагріти до кімнатної температури і акуратно перемішати, поки кристали повністю не розчиняються.
- Забруднена вода або контейнер для приготування реагентів будуть впливати на результати аналізу.

ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ

- Корпорація Cloud-Clone** несе відповідальність тільки за сам набір, але не за зразки, які використовуються в процесі аналізу. Користувач повинен розрахувати можливу кількість зразків, що використовуються в тесті. Будь ласка, приготуйте достатню кількість зразків заздалегідь.
- Будь ласка, розрахуйте концентрацію перед дослідженням. Якщо значення концентрацій не входять в діапазон значень стандартної кривої, користувач повинен визначити оптимальні розведення зразка для конкретного експерименту.
- Зразки плазми потрібно розводити приблизно 1:100. Пропоноване 100-кратне розведення - 10 мкл зразка + 990 мкл PBS. Зразок має бути розведений 0,01 моль/л PBS (рН = 7,0 - 7,2).
- Якщо зразки не вказані в інструкції, необхідно провести попередній експеримент по визначенням обґрунтованості використання набору.

- Екстракційні зразки тканин або клітин, приготовані за допомогою хімічного лізуючого буфера, можуть привести до несподіваних результатів ELISA через вплив деяких хімічних речовин.
- У зв'язку з можливістю розбіжності між антигеном іншого походження і антитілом, використовуваним в даному наборі, деякі нативні або рекомбінантні білки від інших виробників можуть не працювати з даним набором.
- Під впливом факторів, таких як життєздатність клітин, число клітин або час тестування зразків, зразки супернатанту культури клітин можуть бути не виявлені за допомогою набору.
- Для тестування рекомендується використовувати свіжі зразки без тривалого зберігання. В іншому випадку, деградація білків і денатуралізація можуть відбутися в цих зразках, що приведе до невірних результатів.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ

- Визначити кількість лунок для розбавленого стандарту, бланка і взірця. Підготувати 7 лунок для стандарту, 1 лунку для бланка. Додайте 100 мкл кожного з розведеній стандарти (читайте про підготовку реагентів), бланка і зразків у відповідні лунки. Накрити плівкою. Інкубувати протягом 2 годин при 37 °C.
- Видалити рідину з кожної лунки, не мити.
- Додати 100 мкл робочого розчину **Реагенту для детекції А** в кожну лунку. Витримати протягом 1 години при 37 °C після покриття планшета плівкою.
- Аспірувати розчин і промити з використанням 350 мкл 1x Розчину для промивання на кожну лунку, застосовуючи пульверизатор, багатоканальну піпетку, розподільчу колбу або автопромивач, і залишити на 1~2 хвилини. Видалити залишки рідини з лунок повністю, постукавши пластиною на фільтрувальний папір. Промити 3 рази. Після останньої промивки видалити залишки промивного буфера шляхом аспірації або декантування. Перевернути планшет і промокнути його фільтрувальним папером.
- Додати 100 мкл робочого розчину **Реагенту для детекції В** в кожну лунку. Витримати протягом 30 хвилин при 37 °C після покриття планшета плівкою.
- Повторити процес аспірації/промивання всього 5 разів, як описано в кроці 4.
- Додати 90 мкл **Розчину субстрату** в кожну лунку. Покрити новою плівкою. Інкубувати протягом 10-20 хвилин при 37 °C (не більше 30 хвилин). Захищати від світла. Рідина стане синього кольору при додаванні розчину субстрату.
- Додати 50 мкл **Стоп розчину** в кожну лунку. Рідина стане жовтого кольору при додаванні Стоп розчину. Змішати рідину, постукаючи по стороні пластини. Якщо зміна кольору не відбувається, легко постукати по пластині, щоб забезпечити ретельне перемішування.
- Видалити всі краплі води і постукати по нижній частині пластини; впевнитися, що немає бульбашок на поверхні рідини. Потім запустити мікропланшетний зчитувач і провести вимірювання при 450 нм негайно.

Примітка:

- Підготовка до аналізу:** Пригответе відповідну кількість лунок для кожного експерименту і заберіть зразки з планшета. Лунки, які не використовуються, повинні зберігатися при температурі -20 °C.
- Додавання зразків або реагентів:** **Будь ласка, використовуйте свіжо приготований Стандарт.** Обережно додати зразки в лунки і акуратно перемішати, щоб уникнути піноутворення. Не торкатись стінок лунки. Для кожного етапу процедури загальний час дозування для додавання реагентів або зразків в планшет для аналізу не повинен перевищувати 10 хвилин. Це забезпечить рівномірний розподіл часу піпетування для кожного кроку, без переривання. Рекомендується дублювання всіх стандартів і зразків, хоча це не є обов'язковим. Щоб уникнути перехресного забруднення, міняйте наконечники піпеток між додаваннями стандартів, зразків і реагентів. Крім того, використовуйте окремі резервуари для кожного реагенту.
- Інкубація:** Для забезпечення точності результатів необхідне належне проведення герметизації планшета під час інкубації. Не допускайте, щоб лунки залишалися відкритими на довший час між інкубаціями. Як тільки реагенти були додані в лунки, НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ смужкам ВИСИХАТИ в будь-який час під час тесту. Час інкубації і температура повинні контролюватися.
- Промивка:** Процедура промивання є критичною. Повне видалення рідини на кожній стадії має важливе значення для високої продуктивності. Після останньої промивки видалити залишки розчину для промивання шляхом аспірації або декантування і видалити всі краплі води постукуванням кінчиками пальців по нижній частині пластини. Недостатня промивка приводить до низької точності і помилкових підвищених результатів вимірювання.

- Контроль часу реакції:** Спостерігайте за зміною кольору після додавання **Субстрату ТМБ** (наприклад, спостереження кожних 10 хвилин), якщо колір занадто насичений, додайте **Стоп розчин** заздалегідь, щоб уникнути надмірно сильної реакції, що приведе до неточності показань оптичної щільноти.
- Субстрат ТМБ** легко забруднюється. Будь ласка, захищайте його від світла.
- Вологість навколошнього середовища, менша за 60 %, може вплинути на роботу, тому зволожувач повітря рекомендується використовувати в такому стані.

ПРИНЦІП ТЕСТУ


Мікропланшет, який входить до набору, був попередньо покритий антитілом, специфічним до F8. Стандарти та зразки додаються до відповідних лунок планшета з біотин-кон'югованими антитілами, специфічними до F8. Потім додається кон'югат авідин-HRP до кожної лунки мікропланшета і проводиться інкубація. Після додавання розчину субстрату ТМБ, тільки ті лунки, що містять F8, біотинізовані антитіла і фермент-кон'югований авідин, будуть демонструвати зміну в кольорі. Фермент-субстрат Реакція фермент-субстрат зупиняється додаванням розчину сірчаної кислоти і зміна кольору вимірюється спектрофотометрично на довжині хвилі 450 нм ± 10 нм. Концентрація F8 у зразках визначається шляхом порівняння OD зразків на стандартній кривій.

ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ

Визначити середнє значення в дублях для кожного стандарту, контролю і зразків і відняти середнє значення оптичної щільноти нульового стандарту. Побудувати стандартичну криву, відкладаючи середні OD і концентрації для кожного стандарту і провести країші варіанти кривої через точки на графіку або створити стандартичну криву на логарифмічному папері зі значеннями концентрації F8 на осі ординат і абсцисію на осі абсцис. Використання програмного забезпечення, наприклад, Експерта кривої 1.30, також рекомендується. Якщо зразки були розбавлені, концентрацію, яка читається зі стандартної кривої, слід помножити на коефіцієнт розведення.

ТИПОВІ ДАНІ

Для того, щоб зробити розрахунок простішим, ми відкладаємо значення OD стандарту (X-вісь) проти відомої концентрації стандарту (Y-вісь), хоча концентрація є незалежною змінною і значення OD є залежною змінною. Тим не менш, значення OD стандартої кривої можуть мінятися залежно від умов аналізу (наприклад, оператора, техніки піпетування, техніки промивки або температурних впливів). Рекомендується побудова стандартої кривої для кожного тесту. Типова стандартична крива, приведена нижче, призначена тільки для ознайомлення.

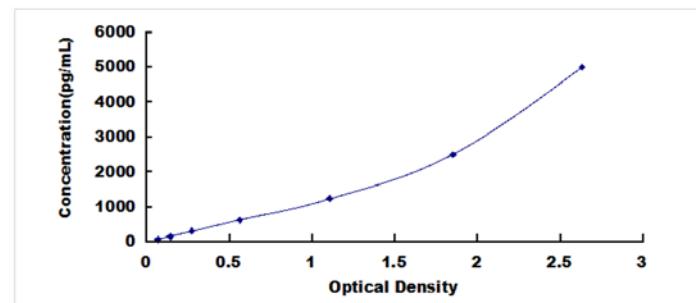

Типова стандартична крива для F8 людини, ELISA

ДІАПАЗОН ВИЯВЛЕННЯ

78-5.000 пг/мл. Концентрації Стандартої кривої, які використовувались для ELISA, були 5.000 пг/мл, 2.500 пг/мл, 1.250 пг/мл, 625 пг/мл, 312 пг/мл, 156 пг/мл, 78 пг/мл.

ЧУТЛИВІСТЬ

Мінімальна доза F8, яка визначається, типово є меншою за 30 пг/мл. Чутливість даного аналізу, або Нижня Межа Виявлення (LLD), була визначена як найнижча концентрація протеїнів, більша за нуль. Вона була розрахована додаванням двох стандартичних відхилень до значення середньої оптичної щільноти 20 нульових стандартів, після чого була розрахована відповідна концентрація.

СПЕЦІФІЧНІСТЬ

Даний аналіз має високу чутливість та надзвичайну специфічність для виявлення F8. Не спостерігалося значної перехресної активності або інтерференції між F8 і аналогами.

Примітка:

У зв'язку з обмеженням навичок та знань, неможливо для нас повністю завершити виявлення перехресної реактивності між F8 і всіма аналогами, тому перехресна реакція може все ще існувати.

ВІДНОВЛЕННЯ

Матриці, перераховані нижче, були насычені певним рівнем рекомбінантного F8 і швидкість відновлення була розрахована шляхом порівняння вимірюваного значення та очікуваної кількості F8 у зразках.

Матриця	Діапазон відновлення,%	Середнє значення, %
Цитратна натрієва плазма (n=5)	84-96	89

ЛІНІЙНІСТЬ

Лінійність набору аналізували за допомогою випробувань зразків, насычених відповідною концентрацією F8, і їх серійних розведенів. Результати були продемонстровані у відсотках розрахункової концентрації до очікуваної.

Зразок	1:2	1:4	1:8	1:16
Цитратна натрієва плазма (n=5)	81-98 %	86-103 %	89-95 %	95-103 %

ТОЧНІСТЬ

Точність в аналізі: 3 зразки з низьким, середнім і високим рівнем F8 були протестовані 20 разів на одній пластині, відповідно.

Точність між аналізами: 3 зразки з низьким, середнім і високим рівнем F8 були протестовані на 3 різних планшетах, 8 повторів на кожному.

CV (%) = SD/середнє X 100

В аналізі: CV < 10%

Між аналізами: CV < 12%

СТАБІЛЬНІСТЬ

Стабільність набору ІФА визначається швидкістю втрати активності. Швидкість зниження активності даного набору складає менше 5% протягом терміну придатності при відповідних умовах зберігання.

Щоб звести до мінімуму додатковий вплив на продуктивність, необхідно дотримуватись порядку проведення тесту і лабораторних умов, особливо кімнатної температури, вологості повітря, температури інкубатора, які мають суворо контролюватися. Крім того, рекомендується, щоб весь аналіз проводився одним і тим же оператором від початку і до кінця.

РЕЗЮМЕ ПРОЦЕДУРИ АНАЛІЗУ

- Підготувати всі реагенти, зразки і стандарти;
- Додати 100 мкл стандарту або взірця в кожну лунку. Інкубувати 2 години при 37 °C;
- Аспірувати і додати 100 мкл підготовленого Реагенту Детекції А. Інкубувати 1 годину при 37 °C;
- Аспірувати і промити 3 рази;
- Додати 100 мкл підготовленого Реагенту Детекції В. Інкубувати 30 хвилин при 37 °C;
- Аспірувати і промити в 5 разів;
- Додати 90 мкл розчину субстрату. Витримати 10-20 хвилин при 37 °C;
- Додати 50 мкл стоп розчину. Зчитати при 450 nm негайно.

ЗАУВАЖЕННЯ

- Обмежені поточним станом та науковими технологіями, ми не можемо повністю провести всебічну ідентифікацію та аналіз сировини, яка надається постачальниками. Тому можуть існувати деякі якісні та технічні ризики при використанні набору.
- Остаточні результати аналізу будуть тісно пов'язані з якістю продукції, операційних навичок кінцевих користувачів і експериментальних умов. Будь ласка, переконайтесь, що достатня кількість зразків є доступною.
- Набори з різних партій може трохи відрізнятися за діапазоном виявлення, чутливістю і часом розвитку забарвлення. Будь ласка, проводьте експеримент в точній відповідності до інструкції, яка додається в комплекті; електронні версії з нашого сайту є тільки інформаційними.
- Забороняється використовувати реагенти з наборів різних партій. Використовуйте тільки Реагенти, що поставляються виробником.
- Захищати всі реагенти від яскравого світла під час зберігання та інкубації. Всі пробки на пляшках з реагентами повинні бути щільно закритими, щоб запобігти випаровуванню і забрудненню мікроорганізмами.
- При першому відкритті в лунках може знаходитись деяка речовина. Це не буде мати ніякого впливу на остаточні результати аналізу. Не виймайте мікротріцаційний планшет з пакету, де він зберігається, поки це не є необхідним.

7. Неправильне операціювання при підготовці реагентів та їх завантаженні, а також помилки в налаштуванні параметрів для планшетів можуть привести до невірних результатів. Мікропланшетний читувач з шириною доріжки 10 nm або менше і діапазоном оптичної щільності 0-3 O.D. або більше при довжині хвилі 450 ± 10 nm є придатним для використання для вимірювання абсорбції. Будь ласка, прочитайте уважно інструкцію і налаштуйте прилад до експерименту. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до операційного відео (<http://www.cloud-clone.us/homepage/operate.htm>).

- Навіть один і той же оператор може отримати різні результати у двох окремих експериментах. Для того, щоб отримати кращу відтворюваність результатів, робота кожного кроку в аналізі повинна контролюватися. Крім того, рекомендується проведення попереднього експерименту перед аналізом для кожної партії.
- Кожен комплект пройшов тест з Контролю якості. Тим не менш, результати від кінцевих користувачів можуть бути несумісними з нашими внутрішніми даними через деякі несподівані умови транспортування або різне устаткування лабораторії. Розбіжність між серіями серед комплектів з різних партій може виникнути в результаті цих факторів, теж.
- Набори від різних виробників можуть призводити до різних результатів, так як ми не порівнювали нашу продукцію з іншими виробниками.
- Інструкція також підходить для набору 48T, але всі реагенти набору 48T зменшені наполовину.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Стоп-розділ, запропонований для використання з цим набором, є розчином кислоти. Використовувати захист для очей, рук, обличчя при роботі з даним матеріалом.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Проблема	Можливе джерело	Коригувальні дії
Погана Стандартна крива	Неправильна підготовка Стандартної кривої	Забезпечити точну роботу розбавлення взірця
	Неповна промивка та аспірація	Адекватні промивка та аспірація
	Неточне піpetування	Перевірити та калібрувати піpetки
Слабка точність	Незавершена промивка лунок	Забезпечити достатню промивку
	Недостатнє перемішування і аспірація реагентів	Адекватні аспірація і змішування реагентів
	Повторне використання піpetок, контейнерів та герметики	Змінити і використовувати нові наконечники, контейнери та герметику
	Неточне піpetування	Перевірити та калібрувати піpetки
Низькі значення O.D.	Недостатні обсяги реагенту, додані в лунки	Провести калібрування піpetок і додати адекватну кількість реагентів
	Невірний час інкубації	Забезпечити достатній час інкубації
	Невірна температура інкубації	Реагенти привести до кімнатної температури
	Не працює кон'югат або субстрат	Змішайте кон'югат і субстрат, колір повинен розвиватися негайно
	Не добавлено Стоп розчин	Дотримуйтесь протоколу аналізу
	Результат зчитано пізно	Зчитайте в терміні, рекомендовані в керівництві
Значення взірців	Неправильне зберігання взірця	Зберігати зразки належним чином і використовувати свіжий зразок
	Невірні забір та підготовка взірців	Вибрать правильний метод забору зразків і їх підготовки
	Недостатня кількість аналіту у взірцях	Використовуйте новий зразок і повторіть аналіз



ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

ТОВ «ДІАМЕБ»
вул. Чорновола, 97
м. Івано-Франківськ, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com